

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 1 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 21081 del 01/07/2021
Ordine di acquisto/Purchase Order	7515 del 21/06/2021
Campione / Sample ⁽¹⁾	COMPONENTE SATELLITE
Descrizione / Description ⁽¹⁾	COMPONENTE SATELLITE
Data ricevimento / Receiving date	01/07/2021
Ns. codice campione / Sample code	21-05025 01-01
Prova richiesta / Test	CT SCAN N 1 RIVELATORE DI PARTICELLE PER VERIFICA ELETTRIDI GEM
Luogo esecuzione prova / Test place	Sede operativa Via Grieco 91 - Campogalliano (MO)
Data inizio prova / Test start date	02/07/2021
Data fine prova / Test end date	06/07/2021

**PROVE NON DISTRUTTIVE – ANALISI TOMOGRAFICA
NON DESTRUCTIVE TESTING – TOMOGRAPHIC ANALYSIS**

Metodo di Prova / Test Method:	PDP 145 REV.00
Norma di Prova / Test Standard:	ISO 15708-1 Rev 2017
Strumentazione / Equipment:	Sistema tomografico NSI X7500 – Tubo minifocus 450 KV– detector Flat Panel pixel pitch 0,200 mm
Campionamento / Sampling:	Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation:	Non Applicabile
Criteri di accettabilità / Acceptance criteria ⁽¹⁾ :	Non Applicabile
Deroghe / Exceptions:	Non Applicabile
Scopo della prova / Scope of testing:	Ricerca discontinuità / Detect discontinuities

⁽¹⁾ Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 2 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

OGGETTO DELLA PROVA / TEST OBJECT	
Componente da esaminare / Part to be tested ⁽¹⁾ :	Rilevatore di particelle
Part Number / Part Number ⁽¹⁾ :	--
Quantità / Quantity :	1
Lista Serial Number Ispezionati / Inspected Serial Number List ⁽¹⁾ :	Non Applicabile
Materiale / Material ⁽¹⁾ :	Rame, Kapton, Honeycomb, Fibra di Carbonio
Metodologia di fabbricazione / Manufacturing process ⁽¹⁾ :	Non Applicabile
Condizioni della superficie / Surface Condition ⁽¹⁾ :	Componente finito
Estensione del controllo / Extent of examination :	100%

RISULTATI DELL'ESAME / TEST RESULTS
NOTE: è stata eseguita l'analisi tomografica sul componente RIVELATORE DI PARTICELLE al fine di verificare eventuali deformazioni interne. Sono state rilevate diverse zone in cui la superficie interna risulta deformata, le principali vengono mostrate nelle immagini seguenti. Vengono riportate, nella parte finale del report, le immagini non planari delle sezioni honeycomb. Per una visione completa degli esiti si rimanda al volume tomografico condiviso con il cliente.

Il Reponsabile della Prova
Ing BORGHI DAVIDE




(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 3 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

VOLUME 3D

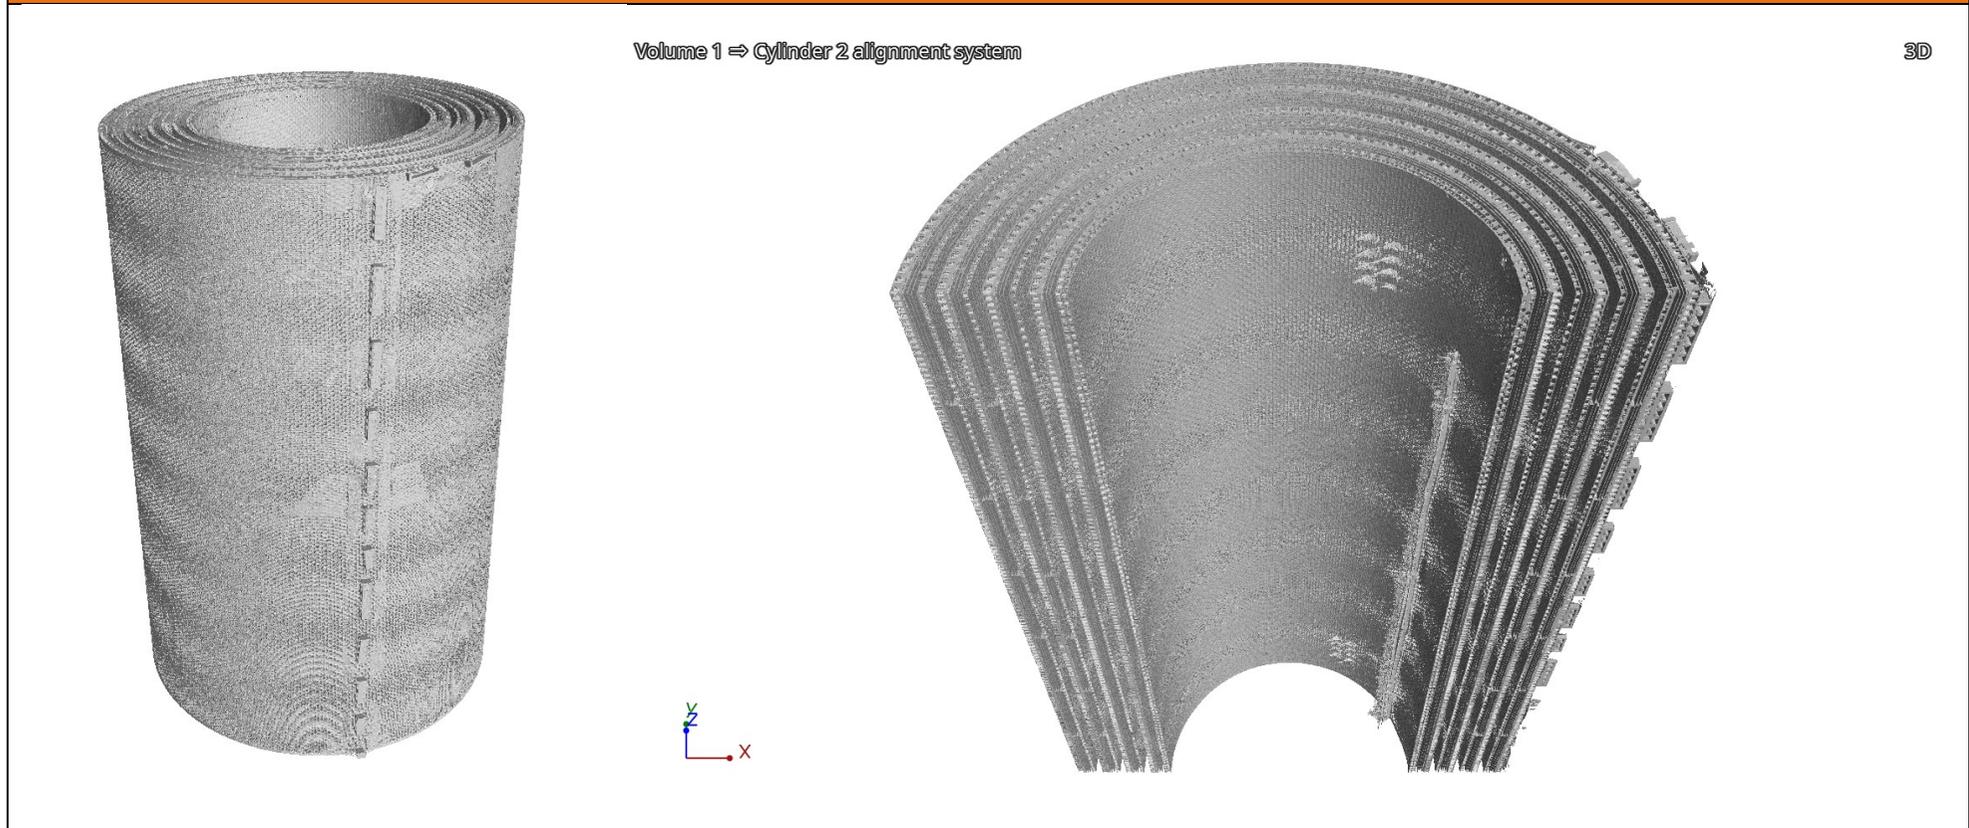


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 4 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

ZERO – VISTA TRASVERSALE

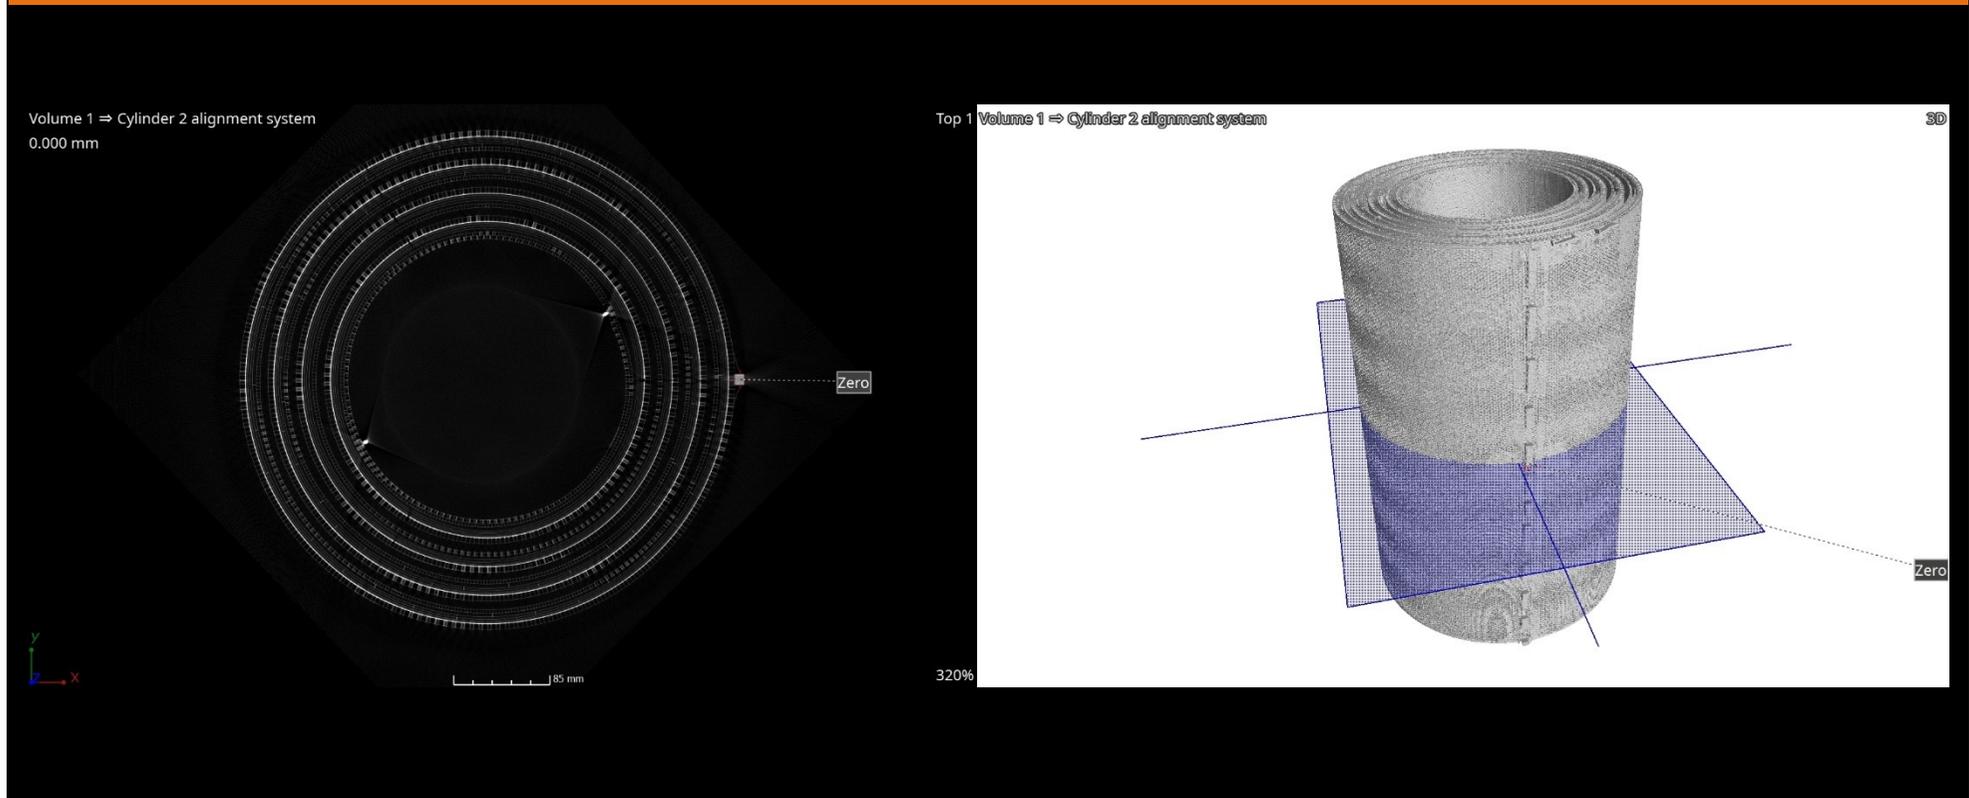


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 5 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 1 – VISTA TRASVERSALE

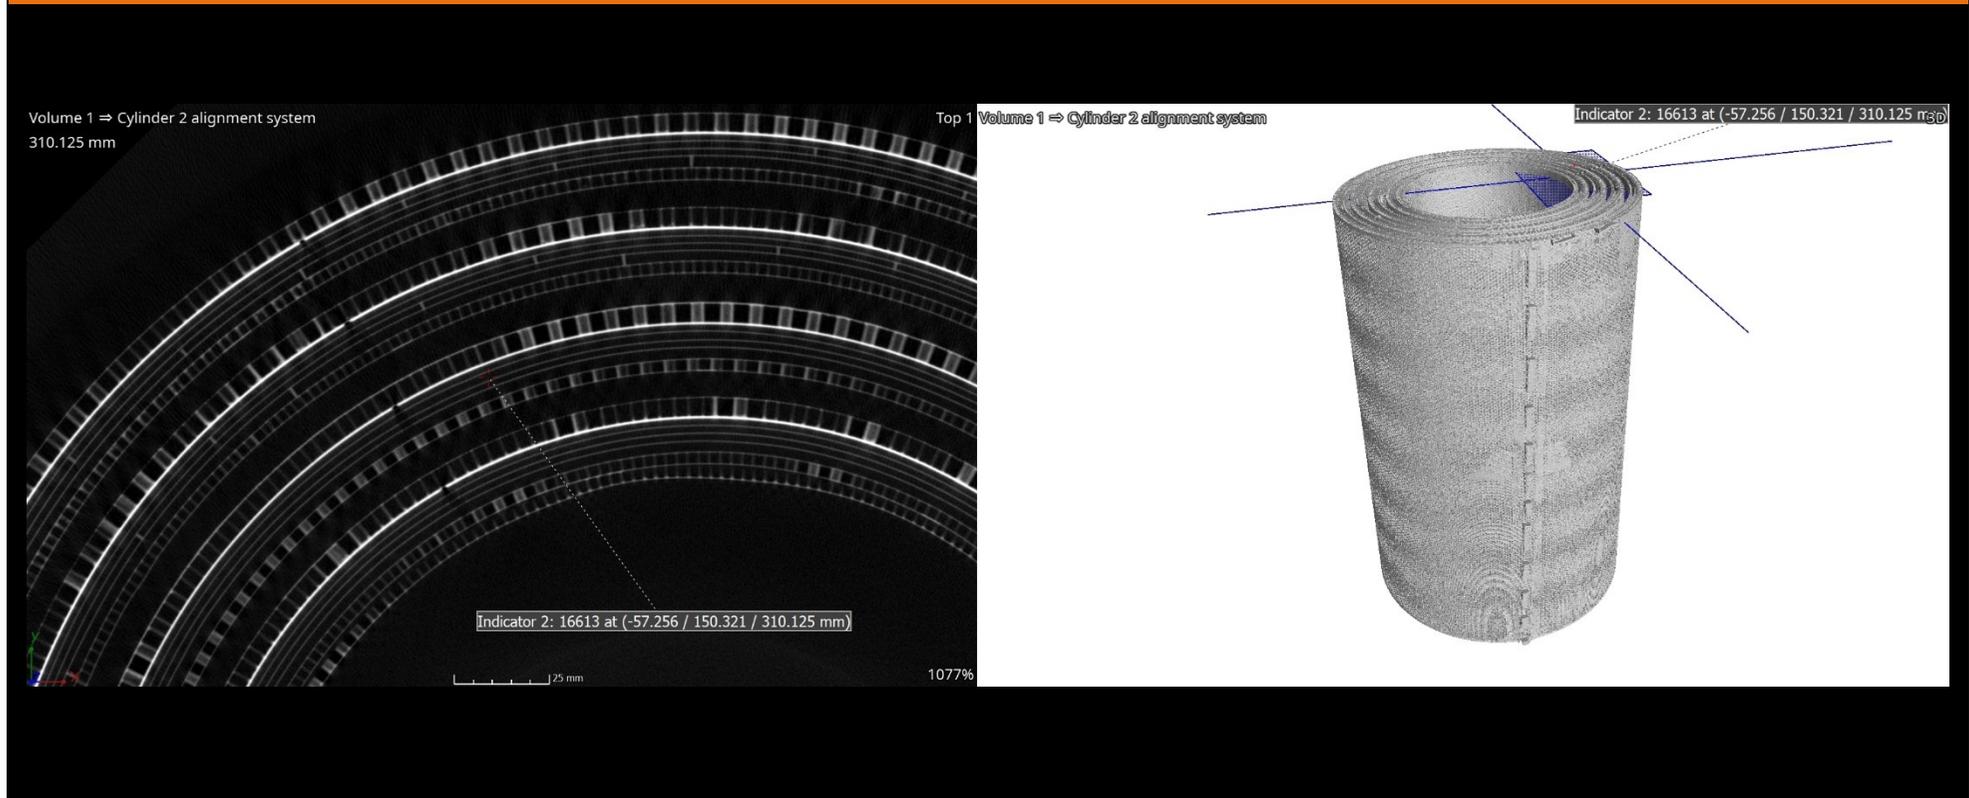


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 6 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 2 – VISTA TRASVERSALE

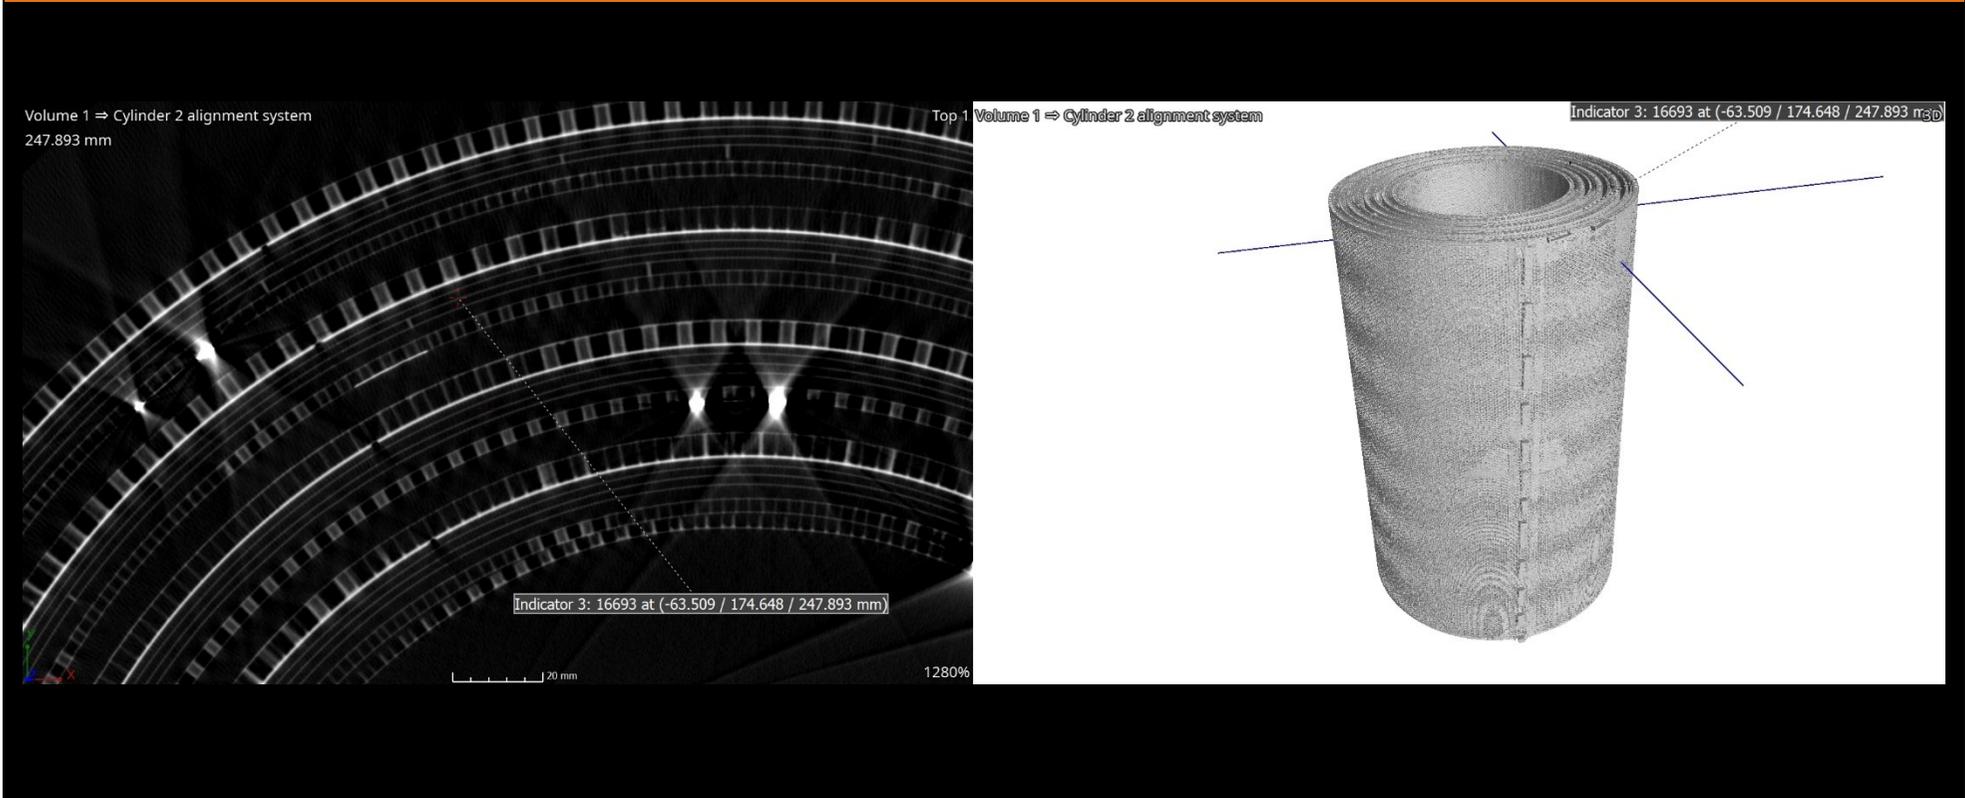


Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa

(1) Dati forniti dal cliente
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 7 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 3 – VISTA TRASVERSALE

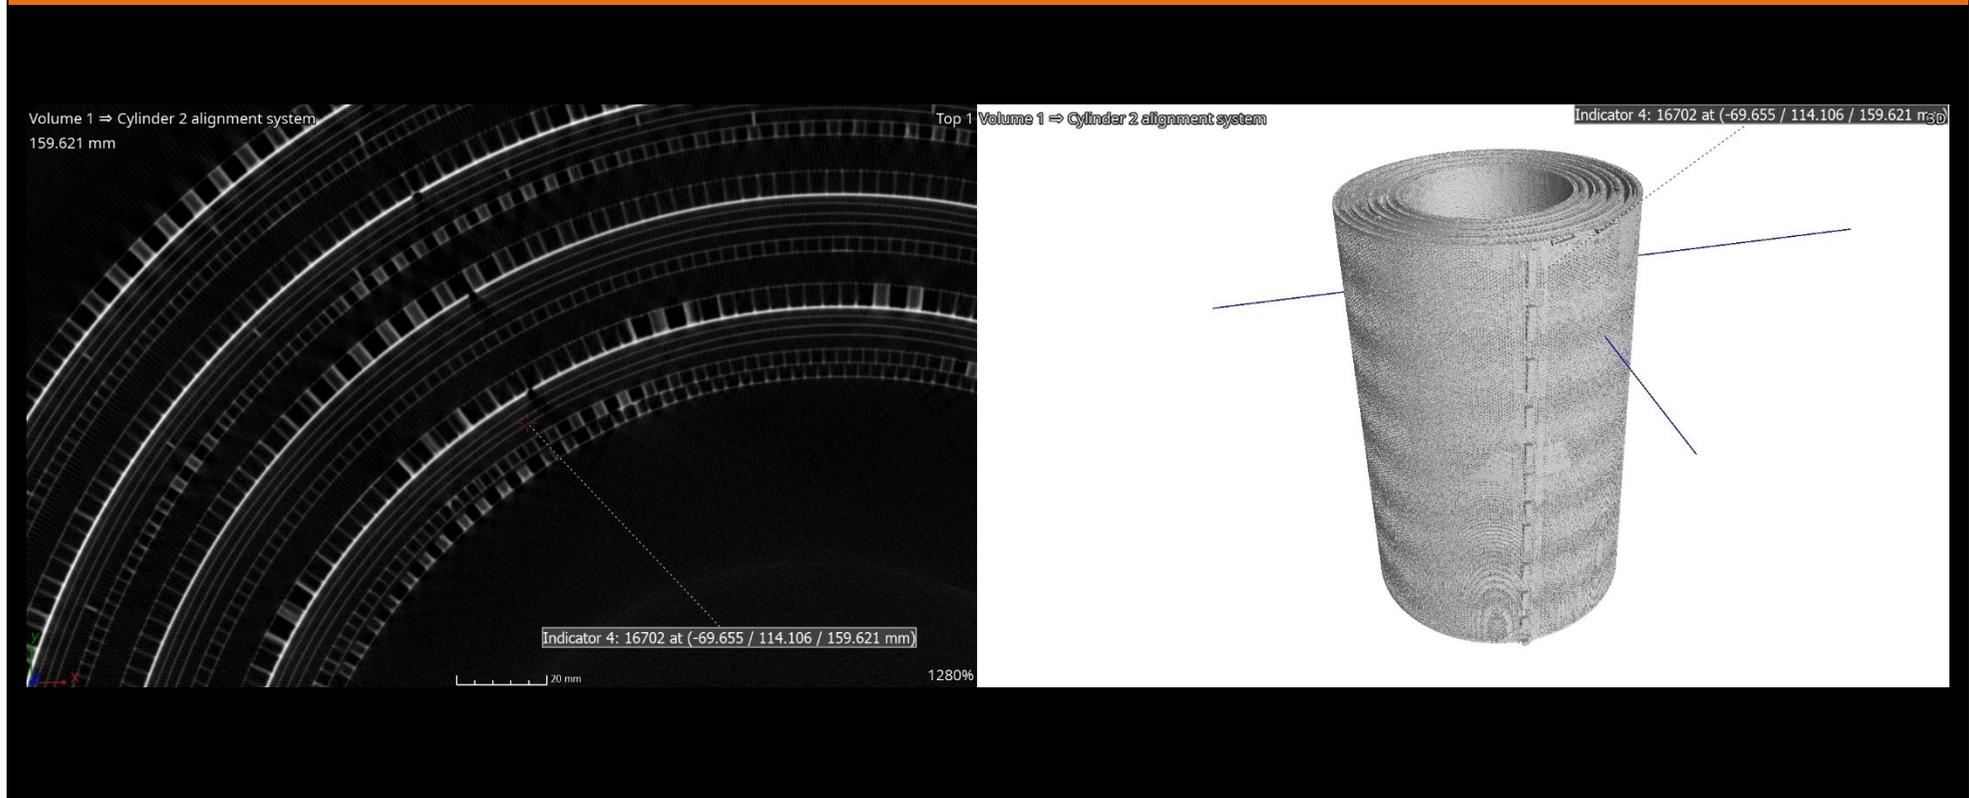

Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 8 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 4 – VISTA TRASVERSALE

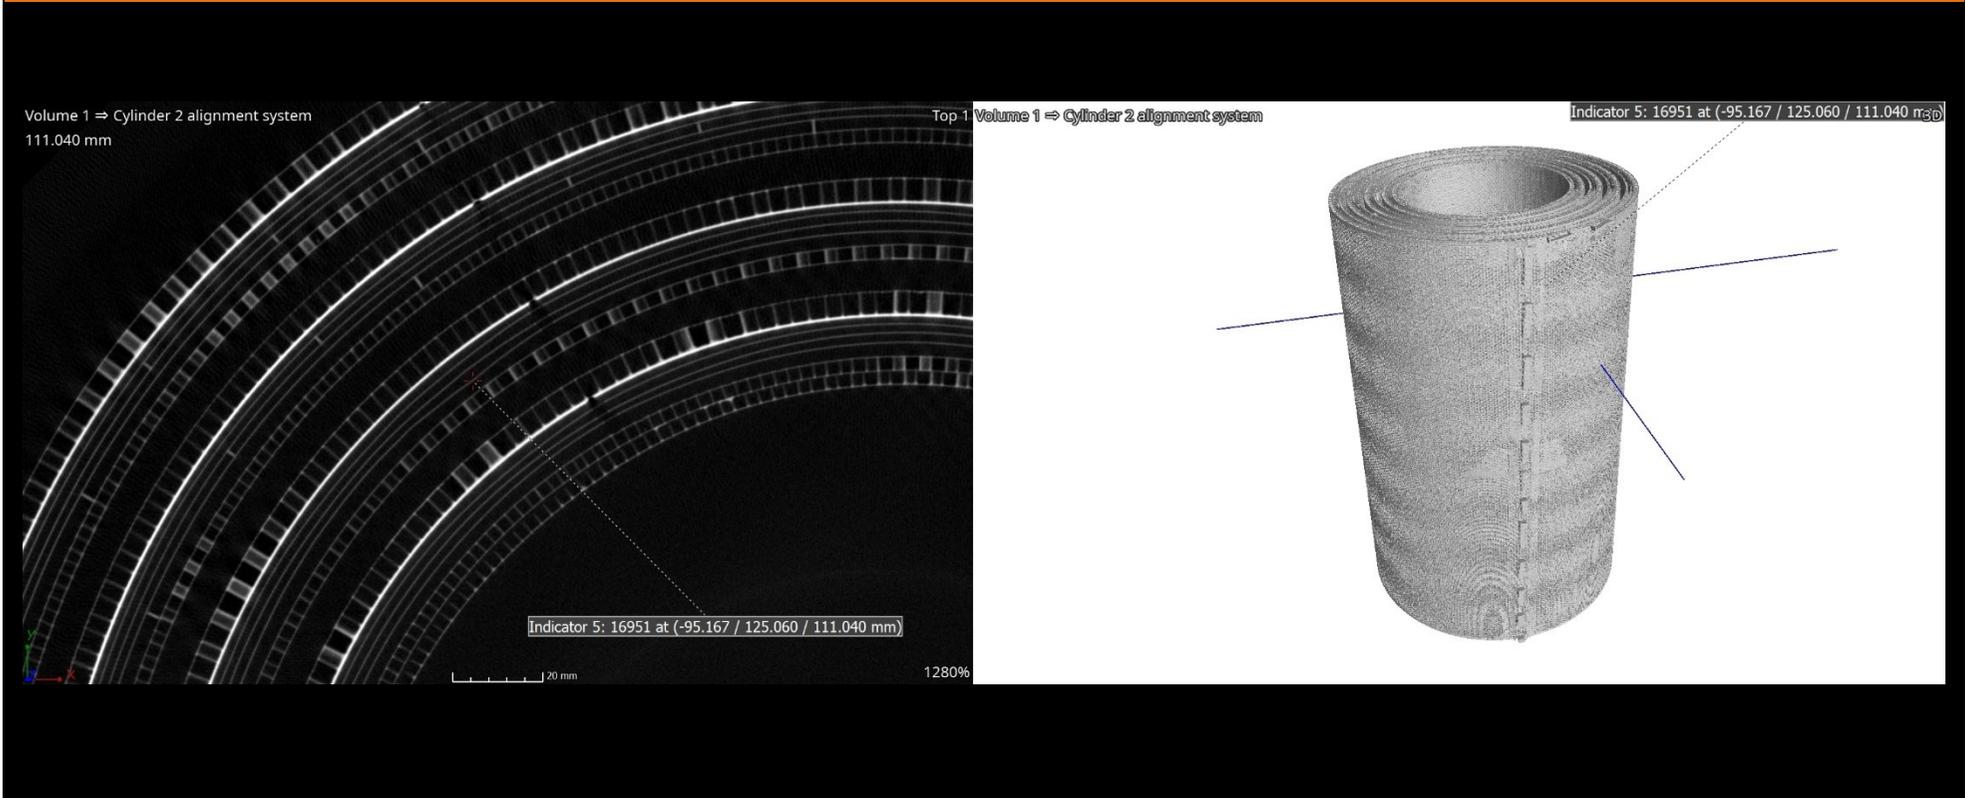

Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 9 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 5 – VISTA TRASVERSALE

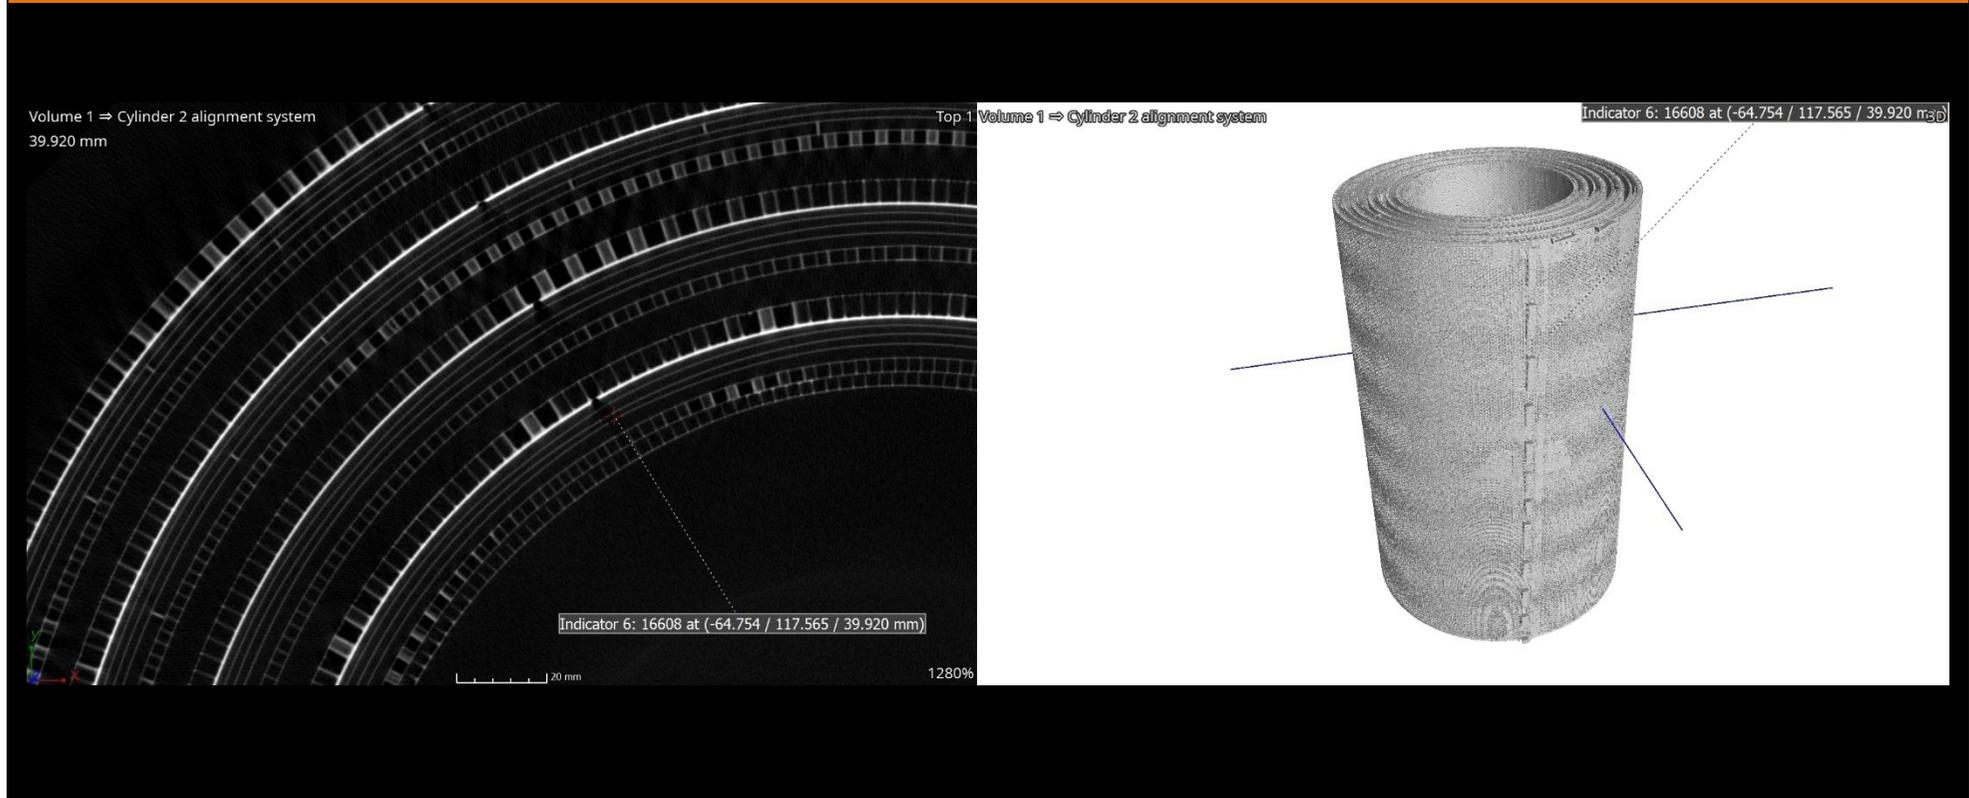

Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 10 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 6 – VISTA TRASVERSALE

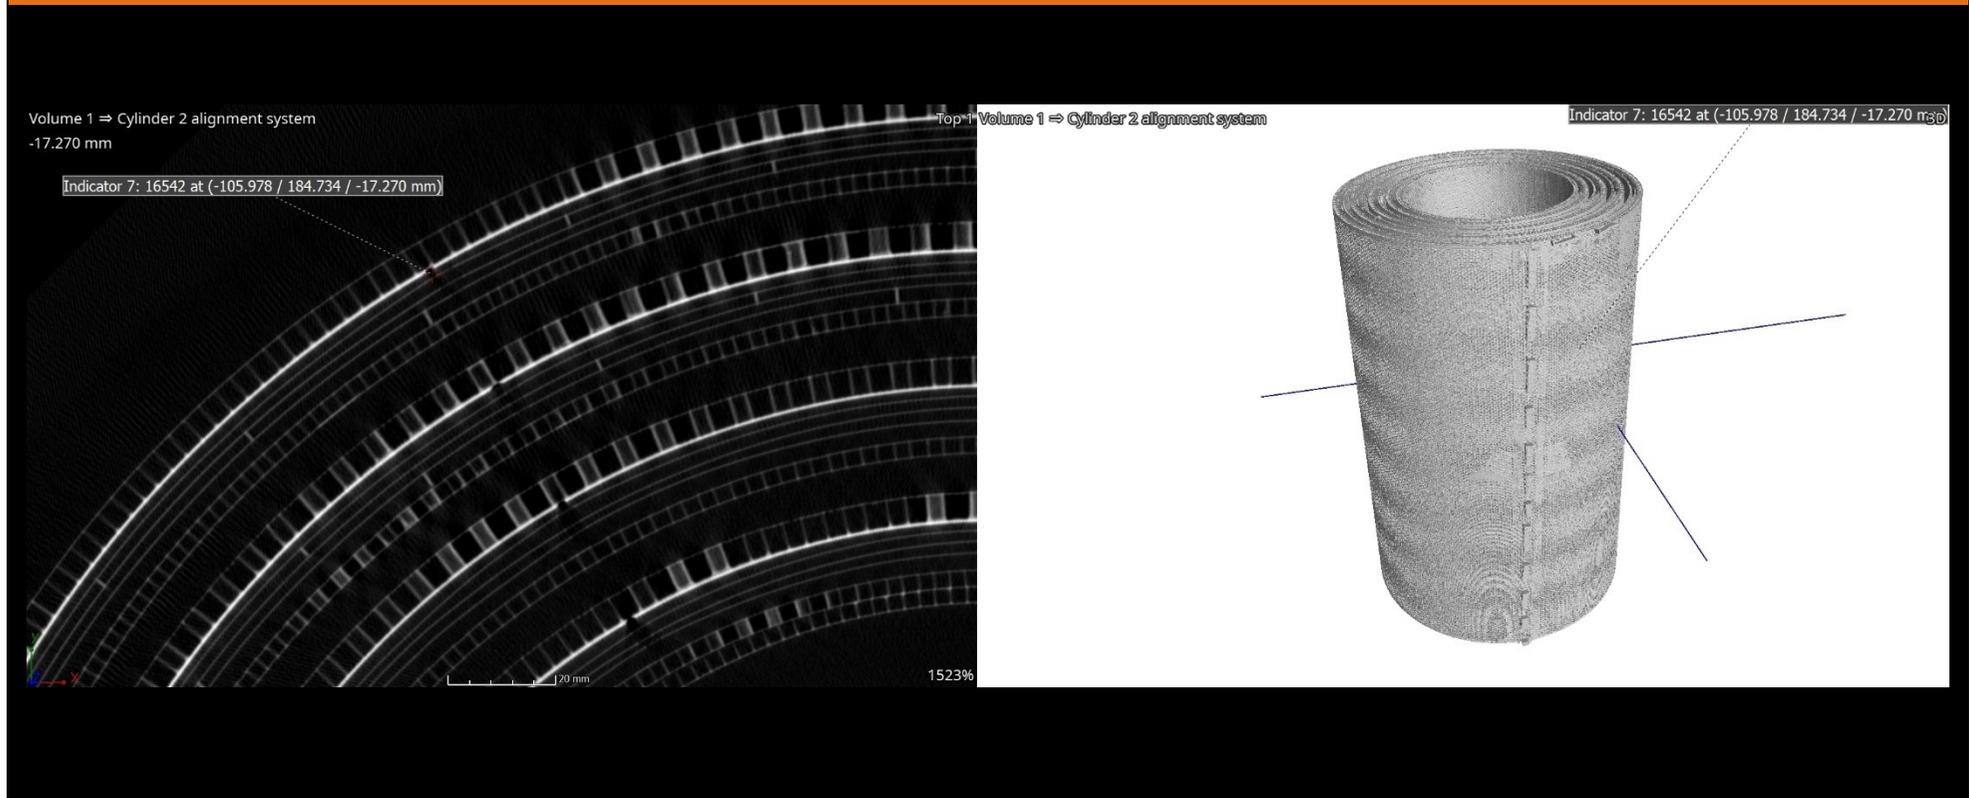

Firmato digitalmente da: BENNUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 11 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 7 – VISTA TRASVERSALE

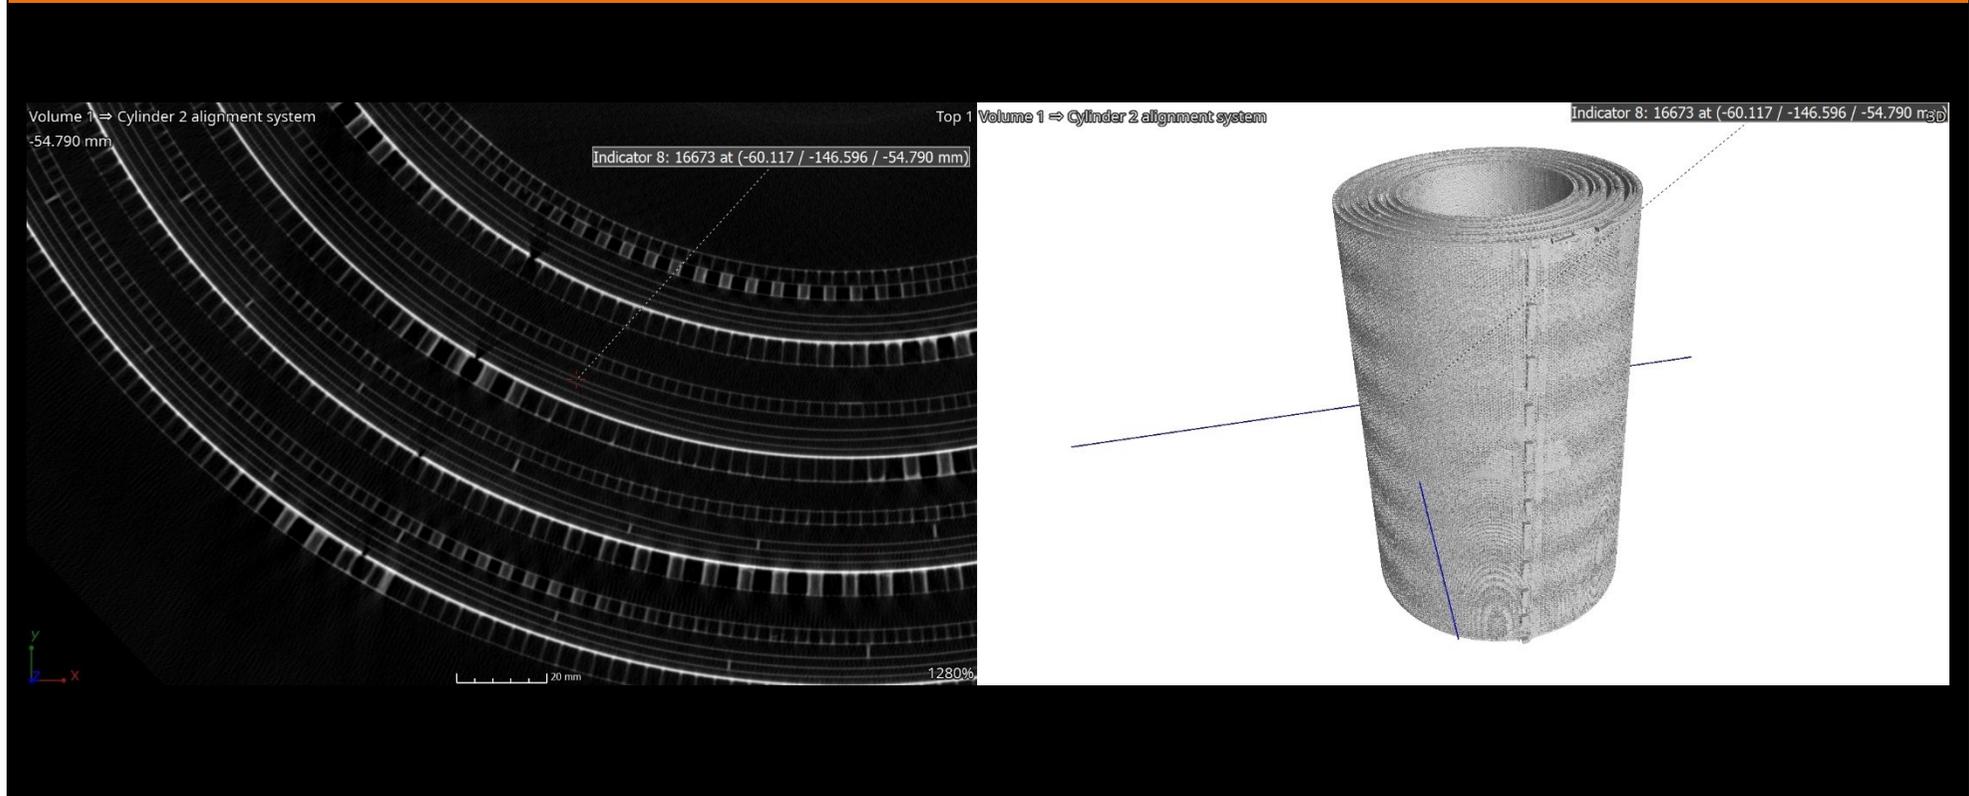

Firmato digitalmente da: BENNUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 12 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 8 – VISTA TRASVERSALE

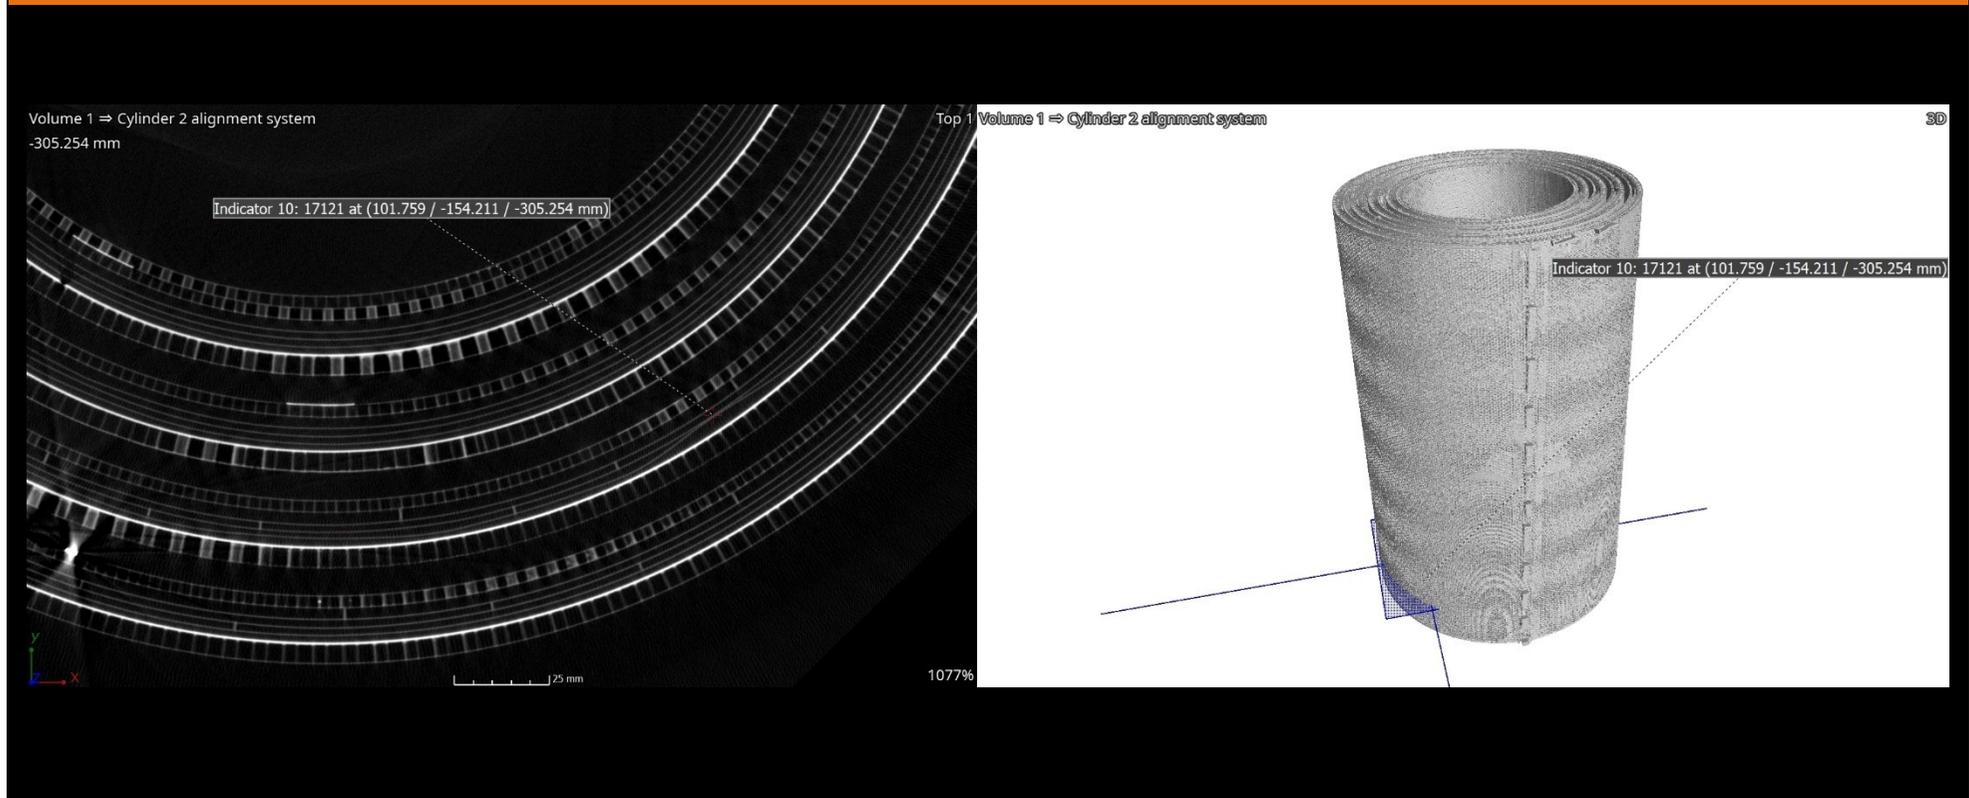

Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 13 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 9 – VISTA ROTAZIONALE

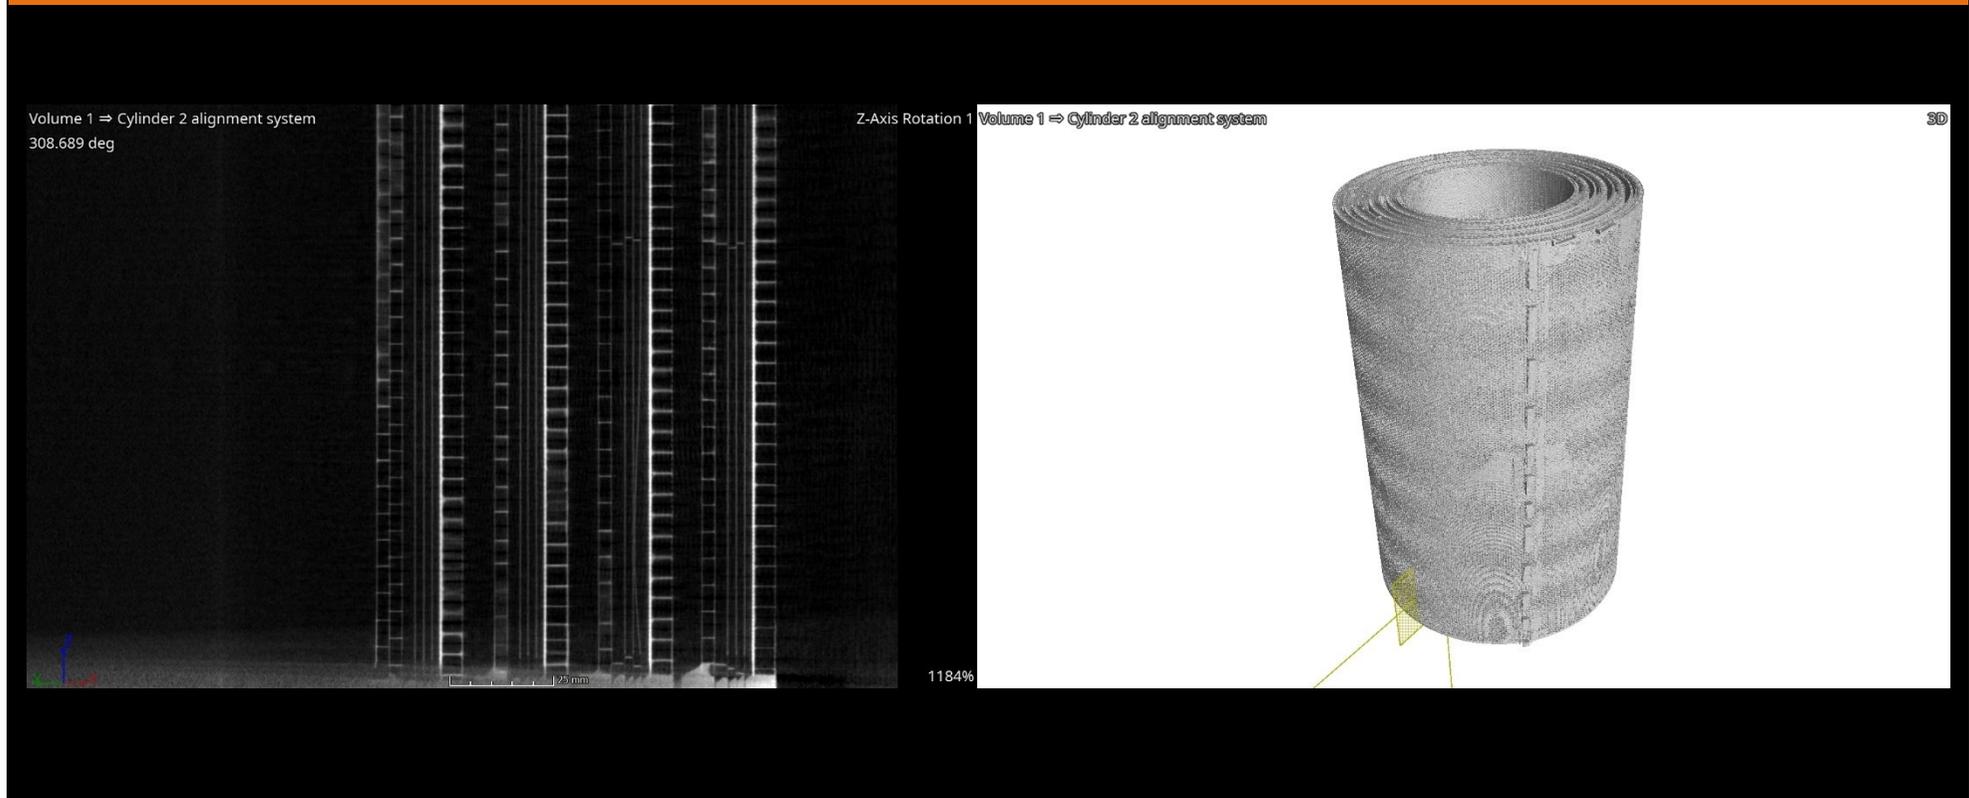

Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 14 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 9 – VISTA TRASVERSALE

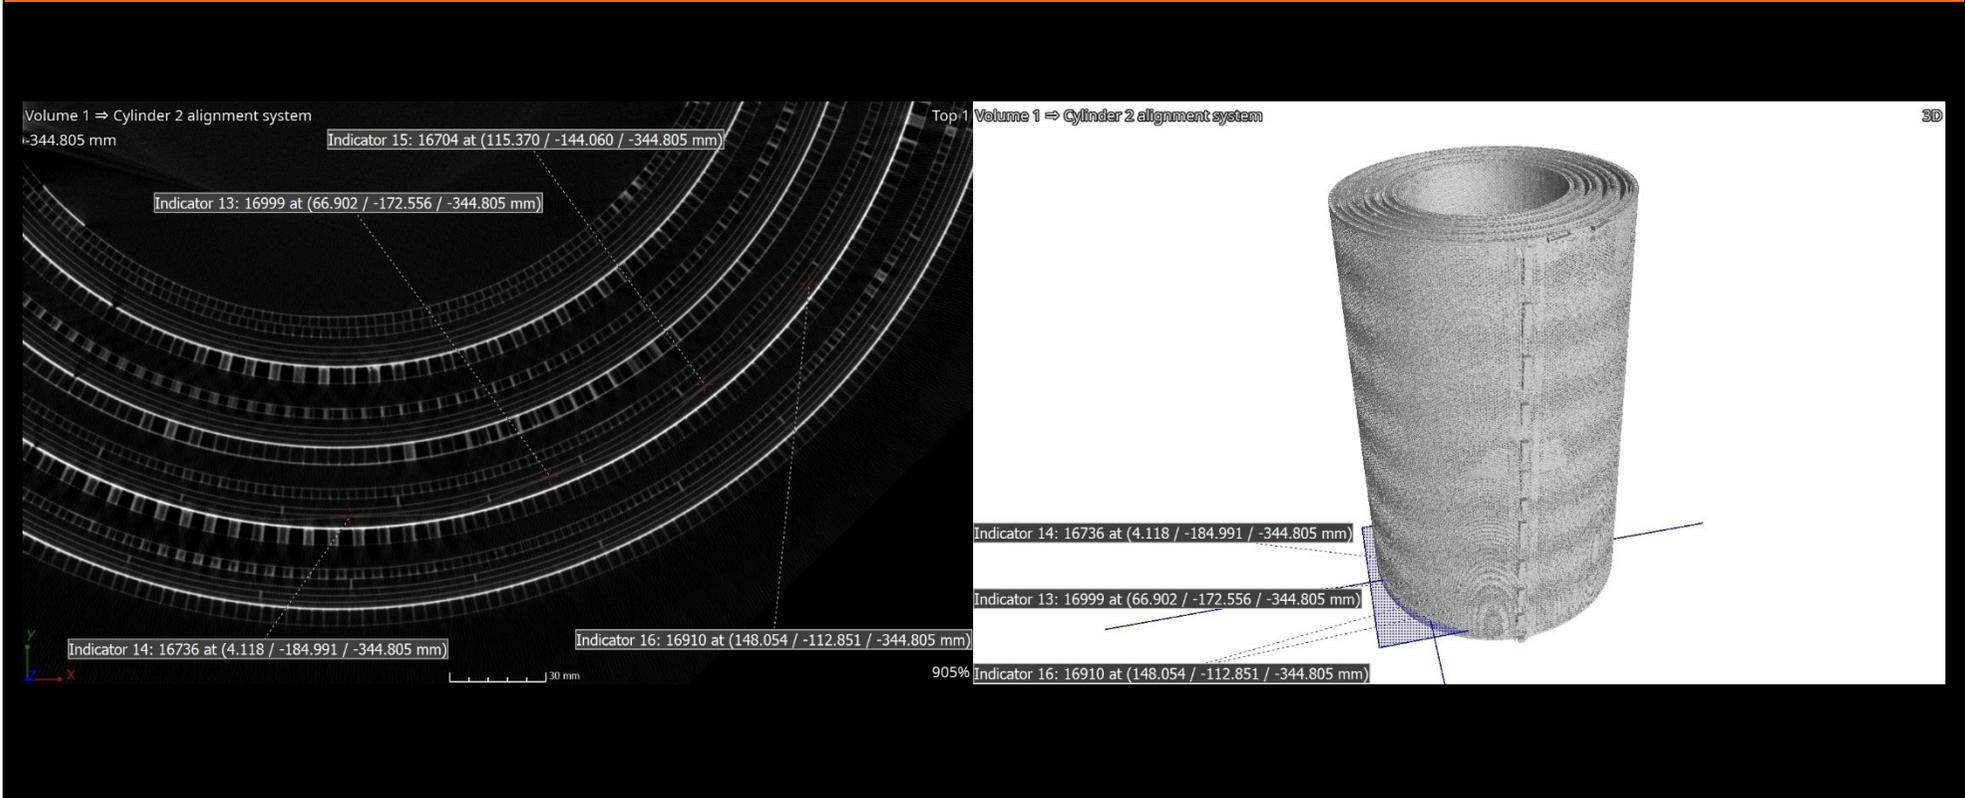


Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa

(1) Dati forniti dal cliente
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 15 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

INDICAZIONE 9 – VISTA NON PLANARE

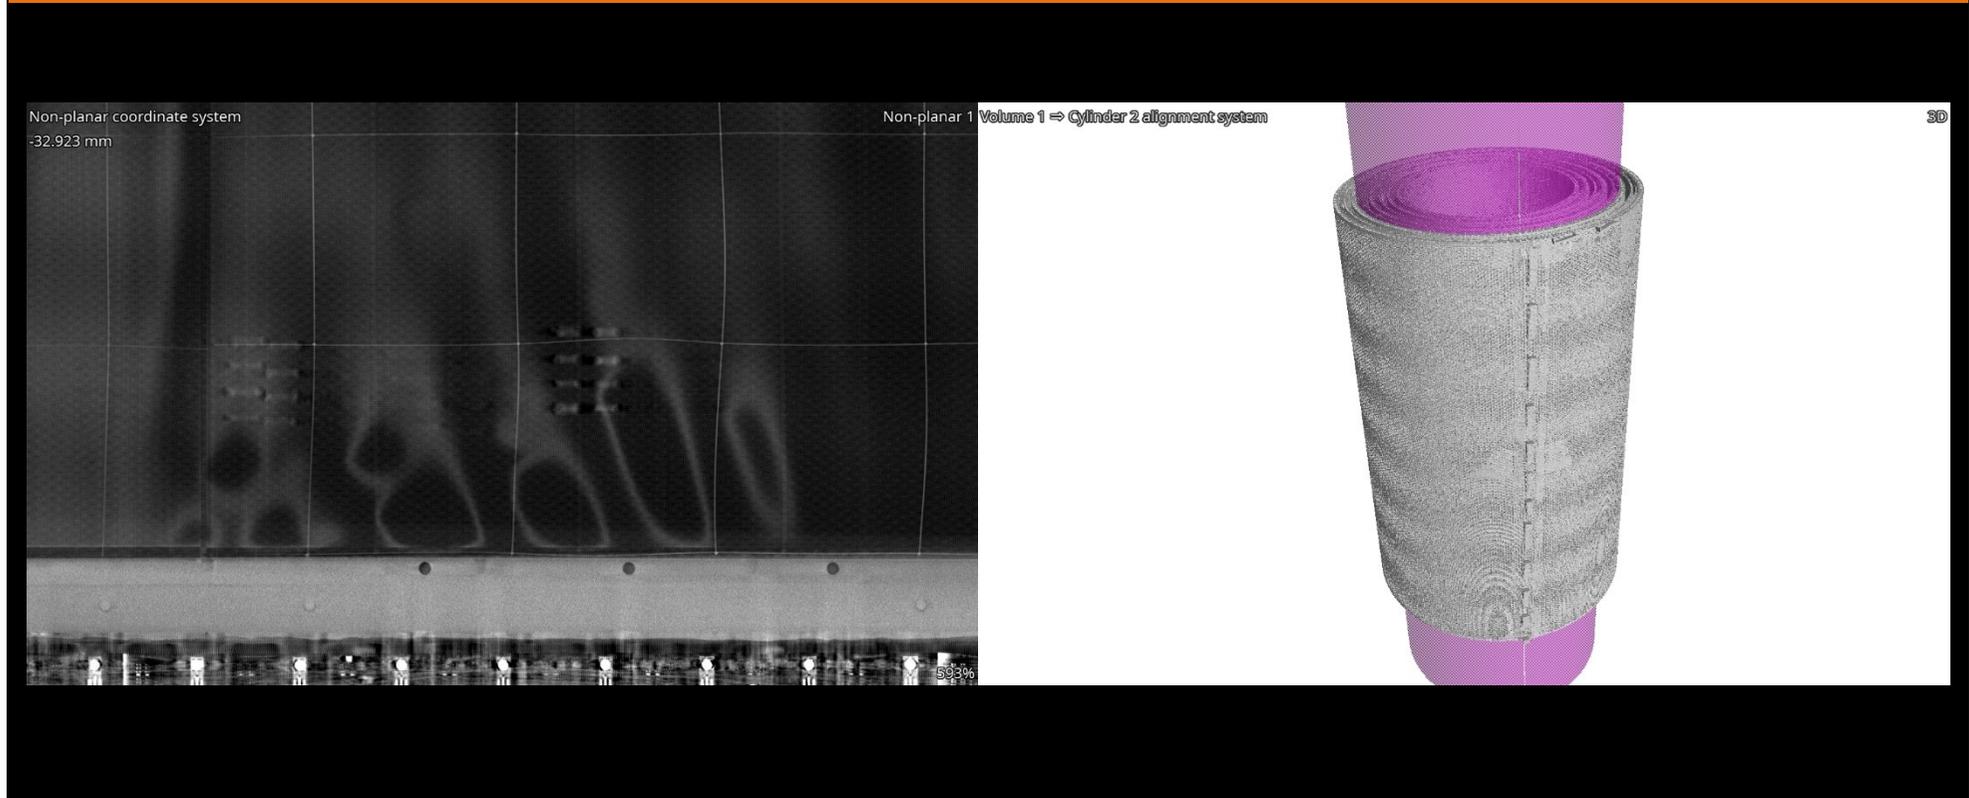


Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa

(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 1 – VISTA NON PLANARE

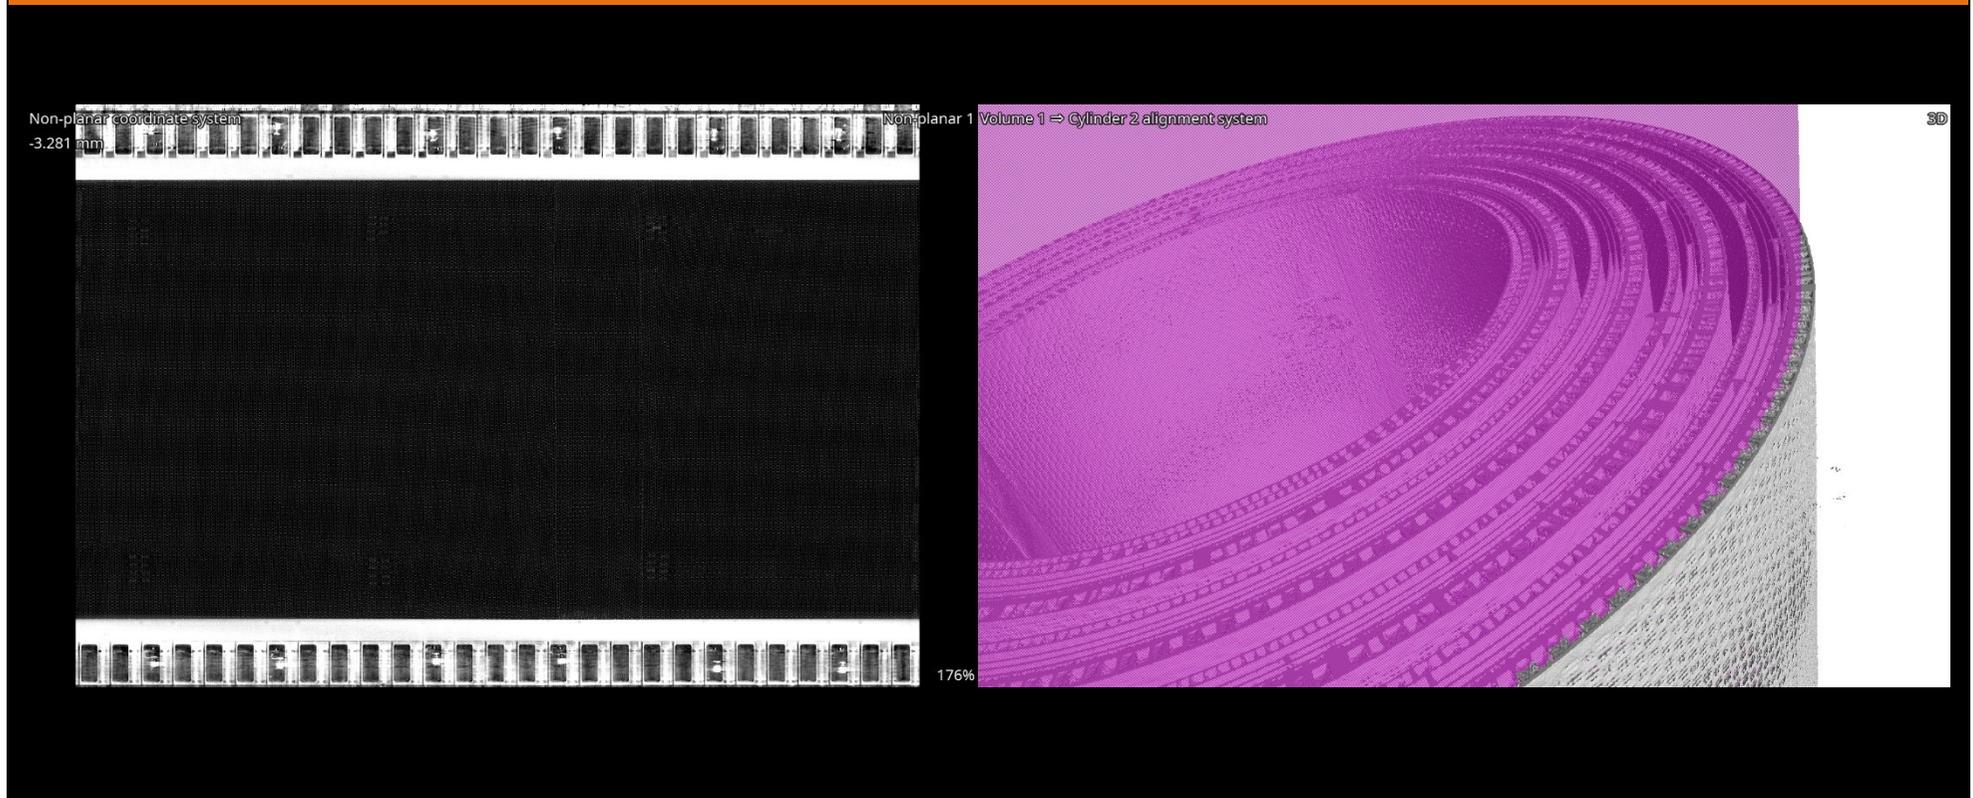


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 17 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 1-1 – VISTA NON PLANARE

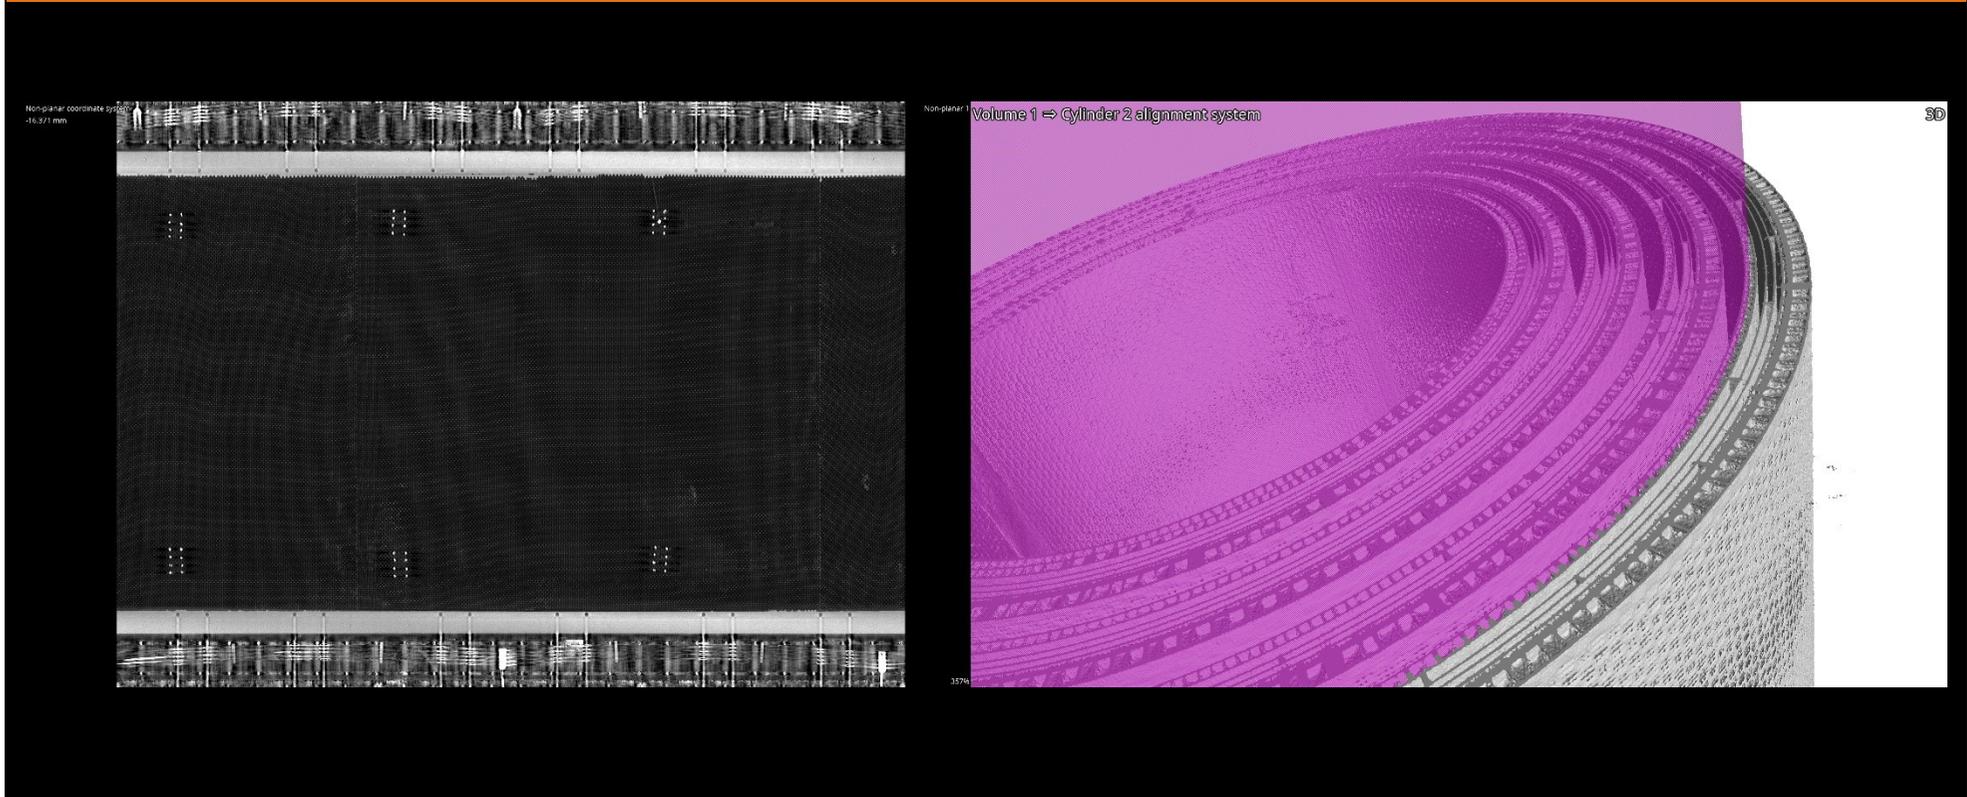


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 18 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
----------------------------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 2 – VISTA NON PLANARE

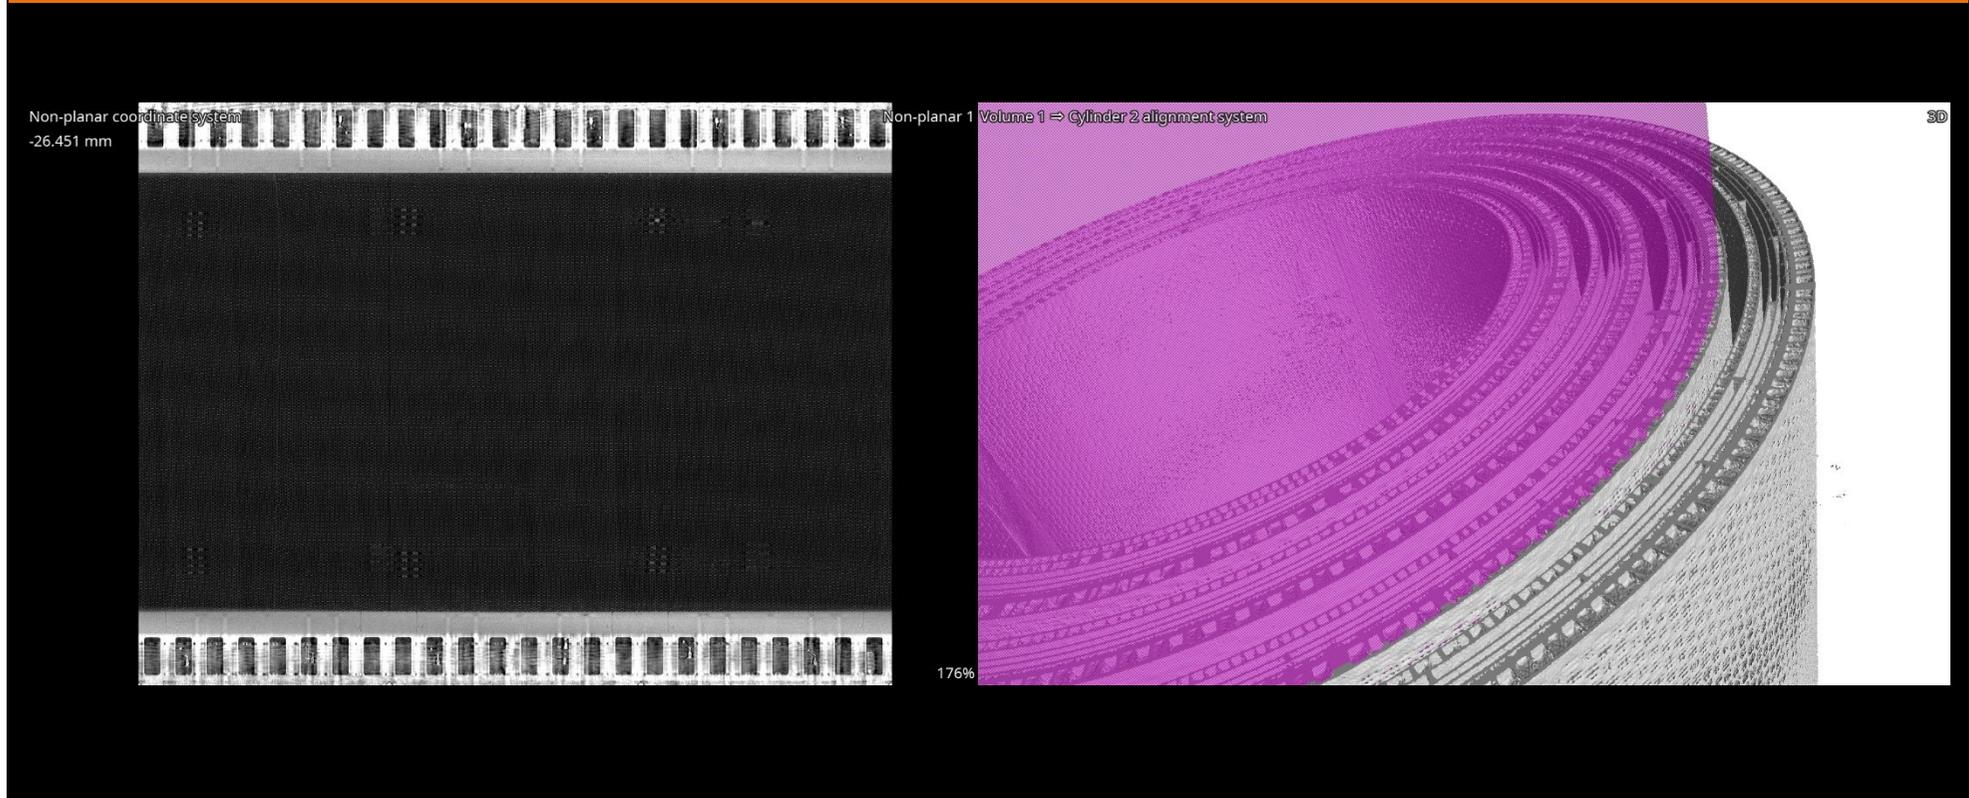


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 19 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 2-1 – VISTA NON PLANARE

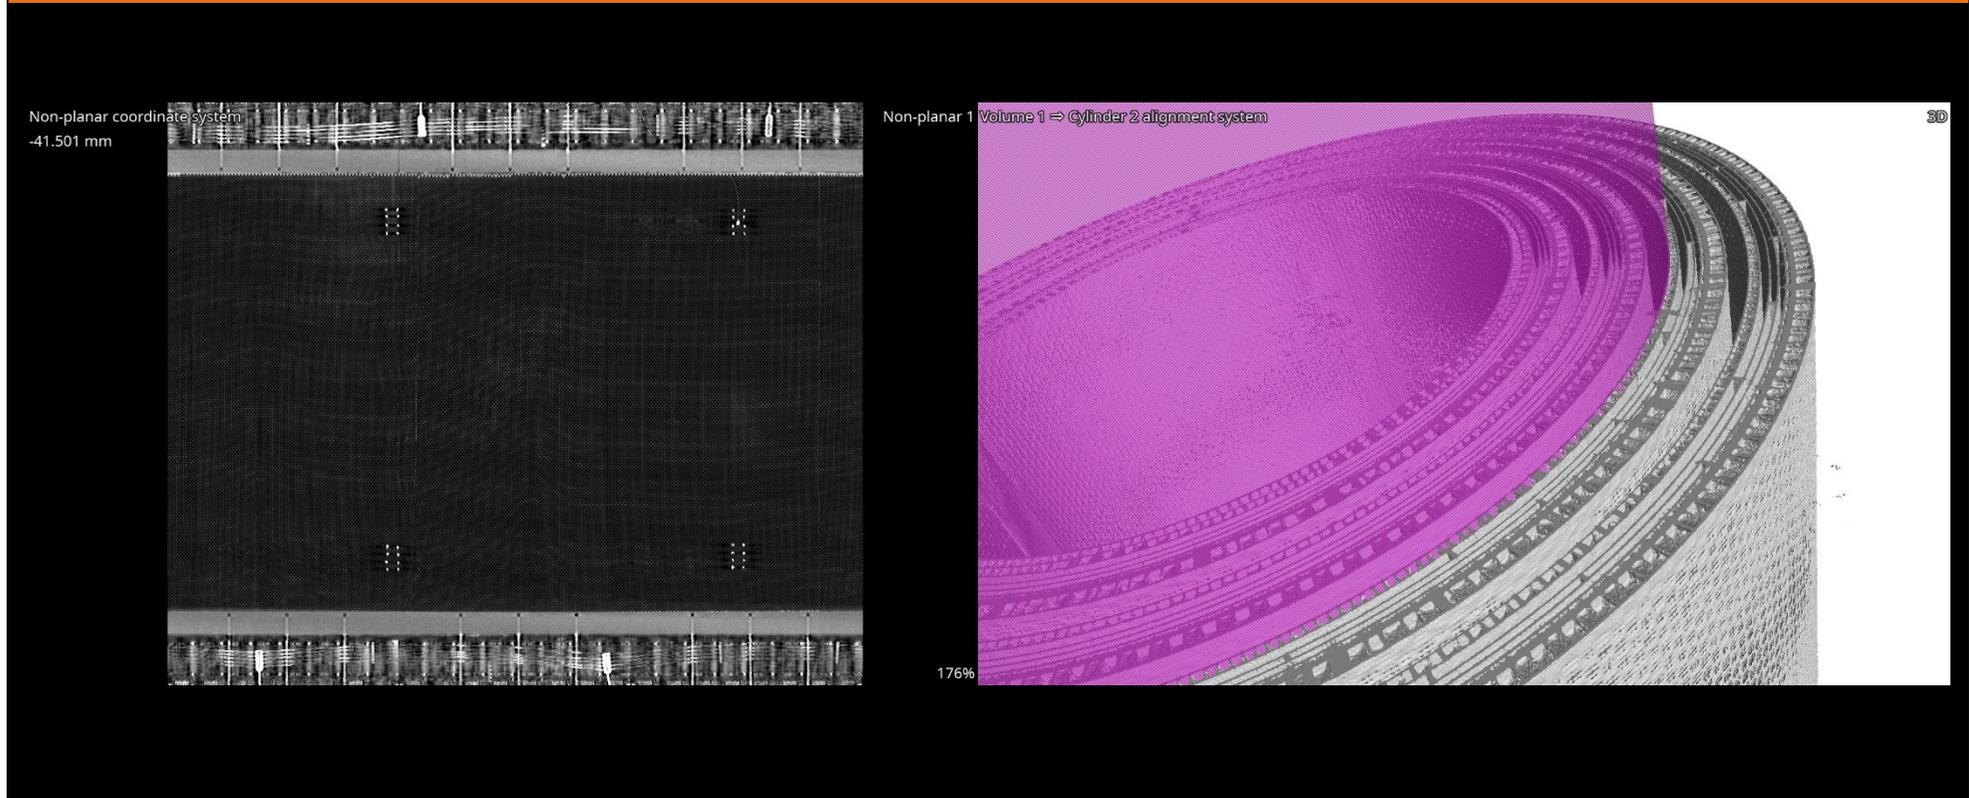


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 3 – VISTA NON PLANARE

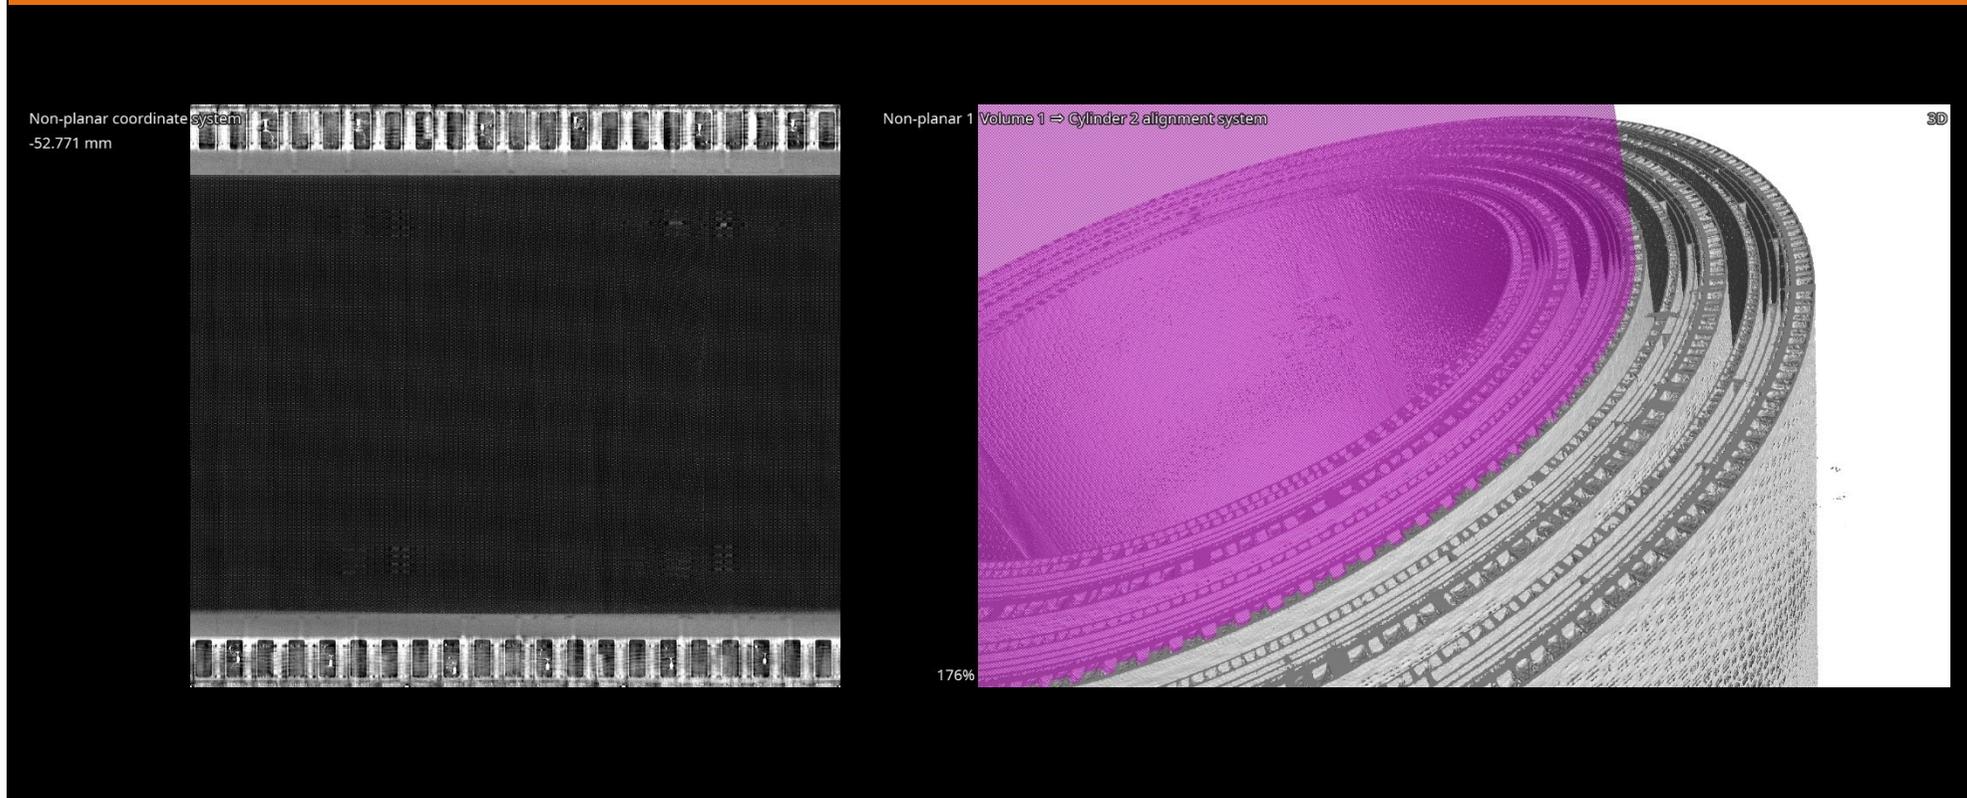


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 21 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 3-1 – VISTA NON PLANARE

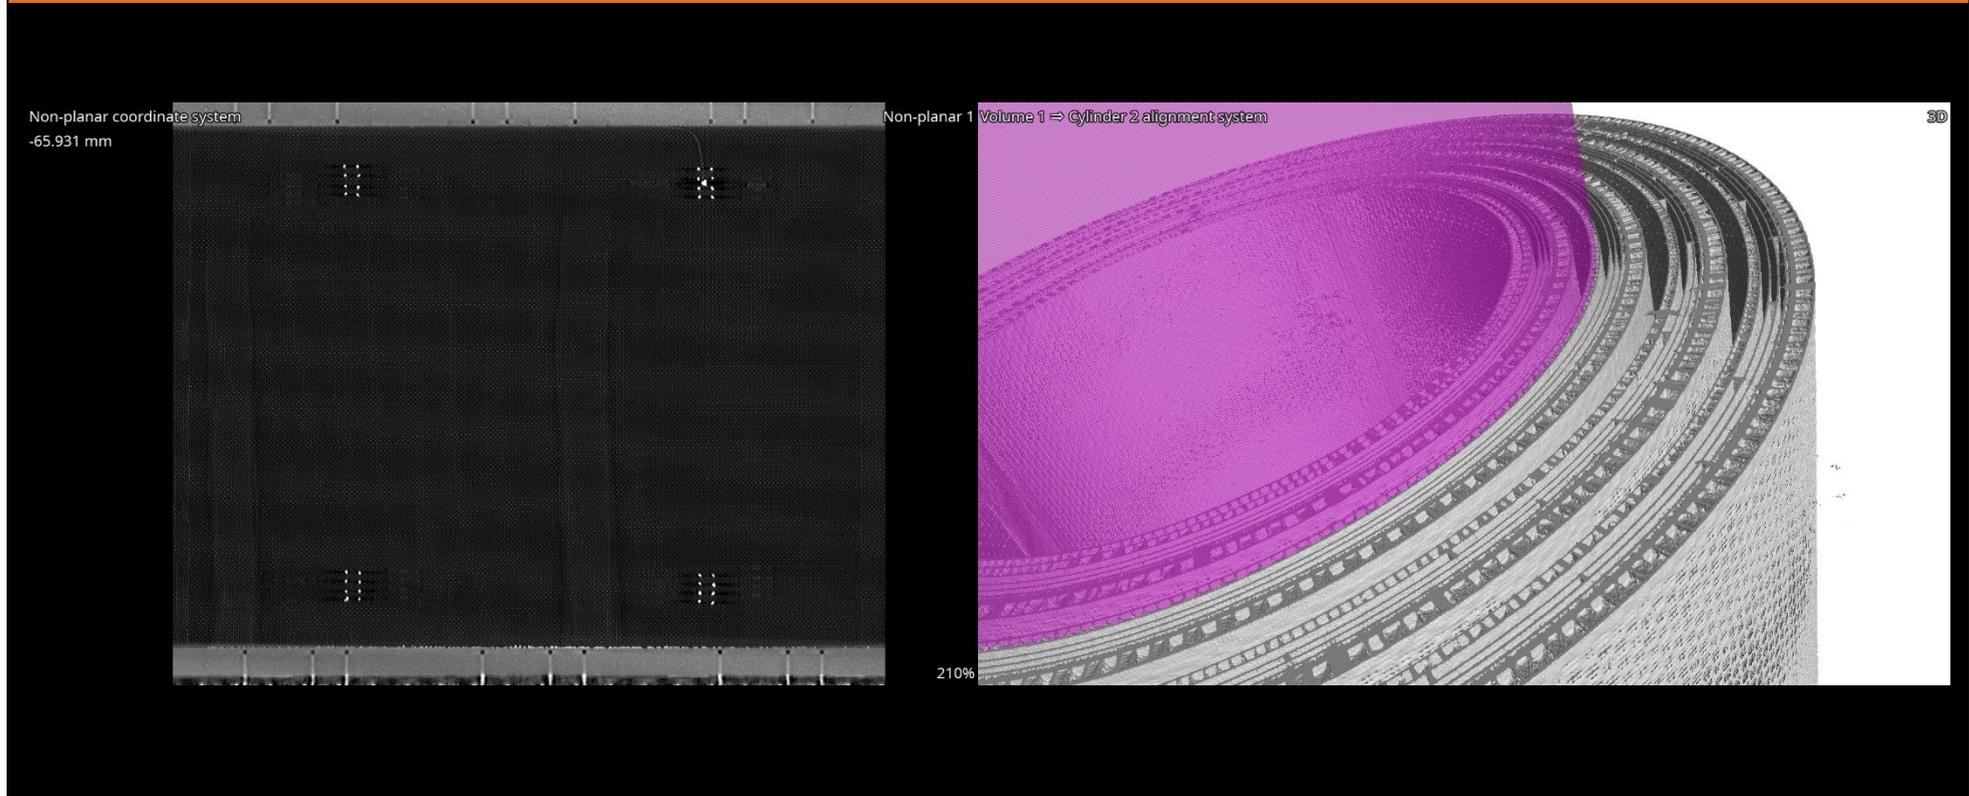


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 22 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 4 – VISTA NON PLANARE

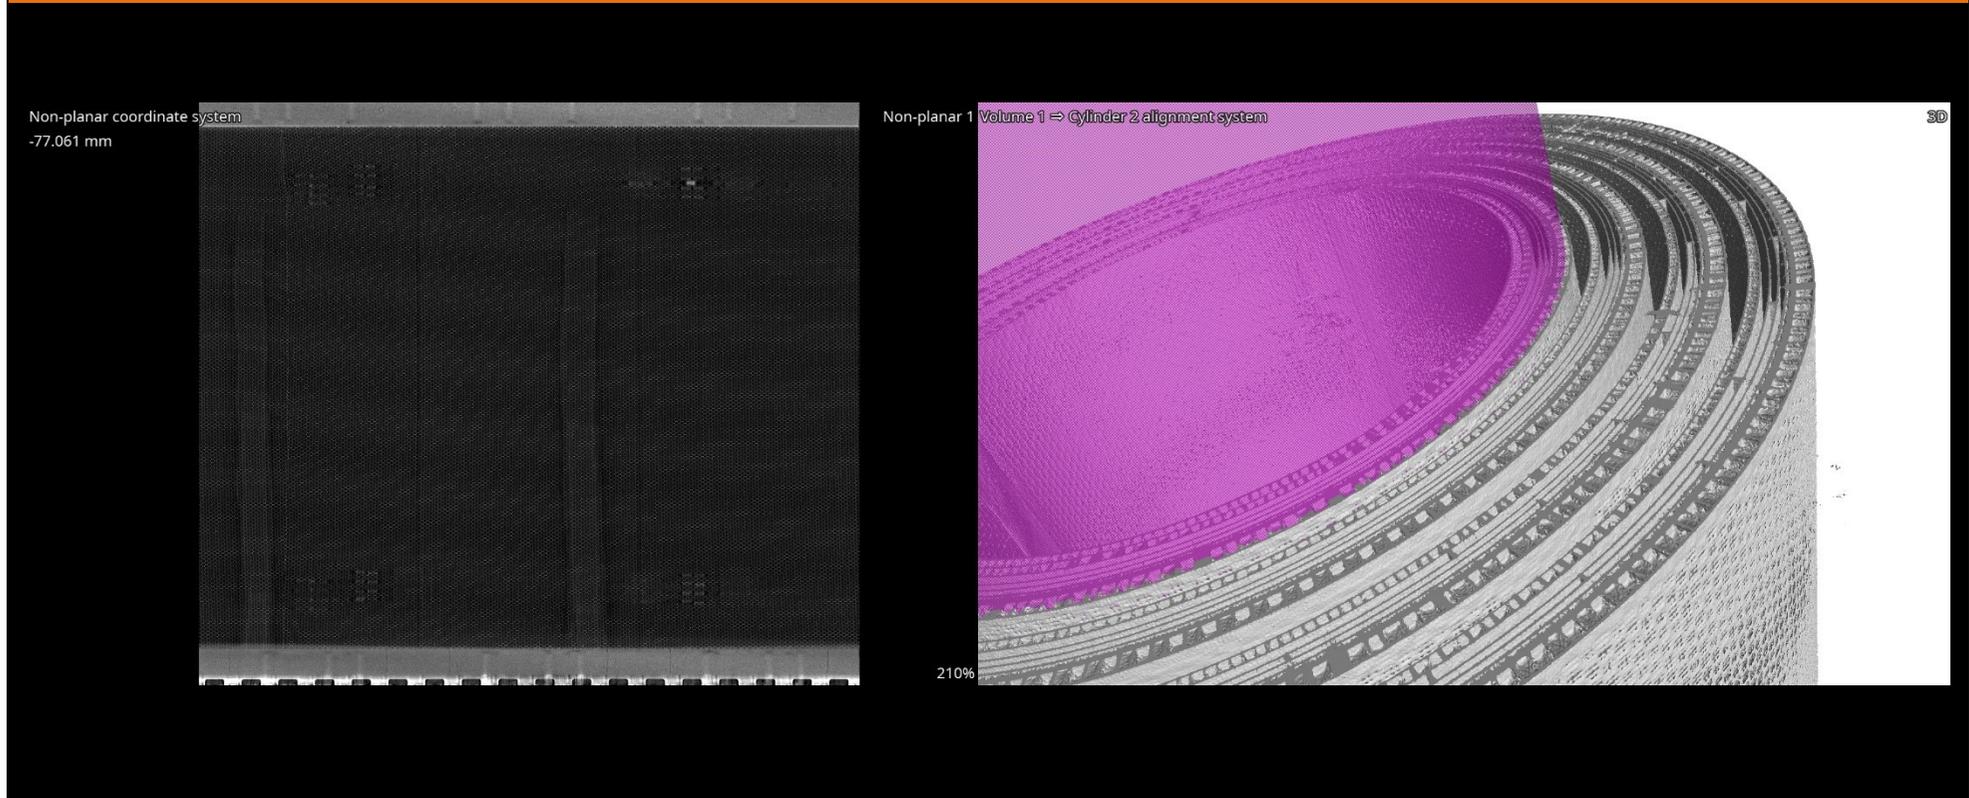


(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 23 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 4-1 – VISTA NON PLANARE

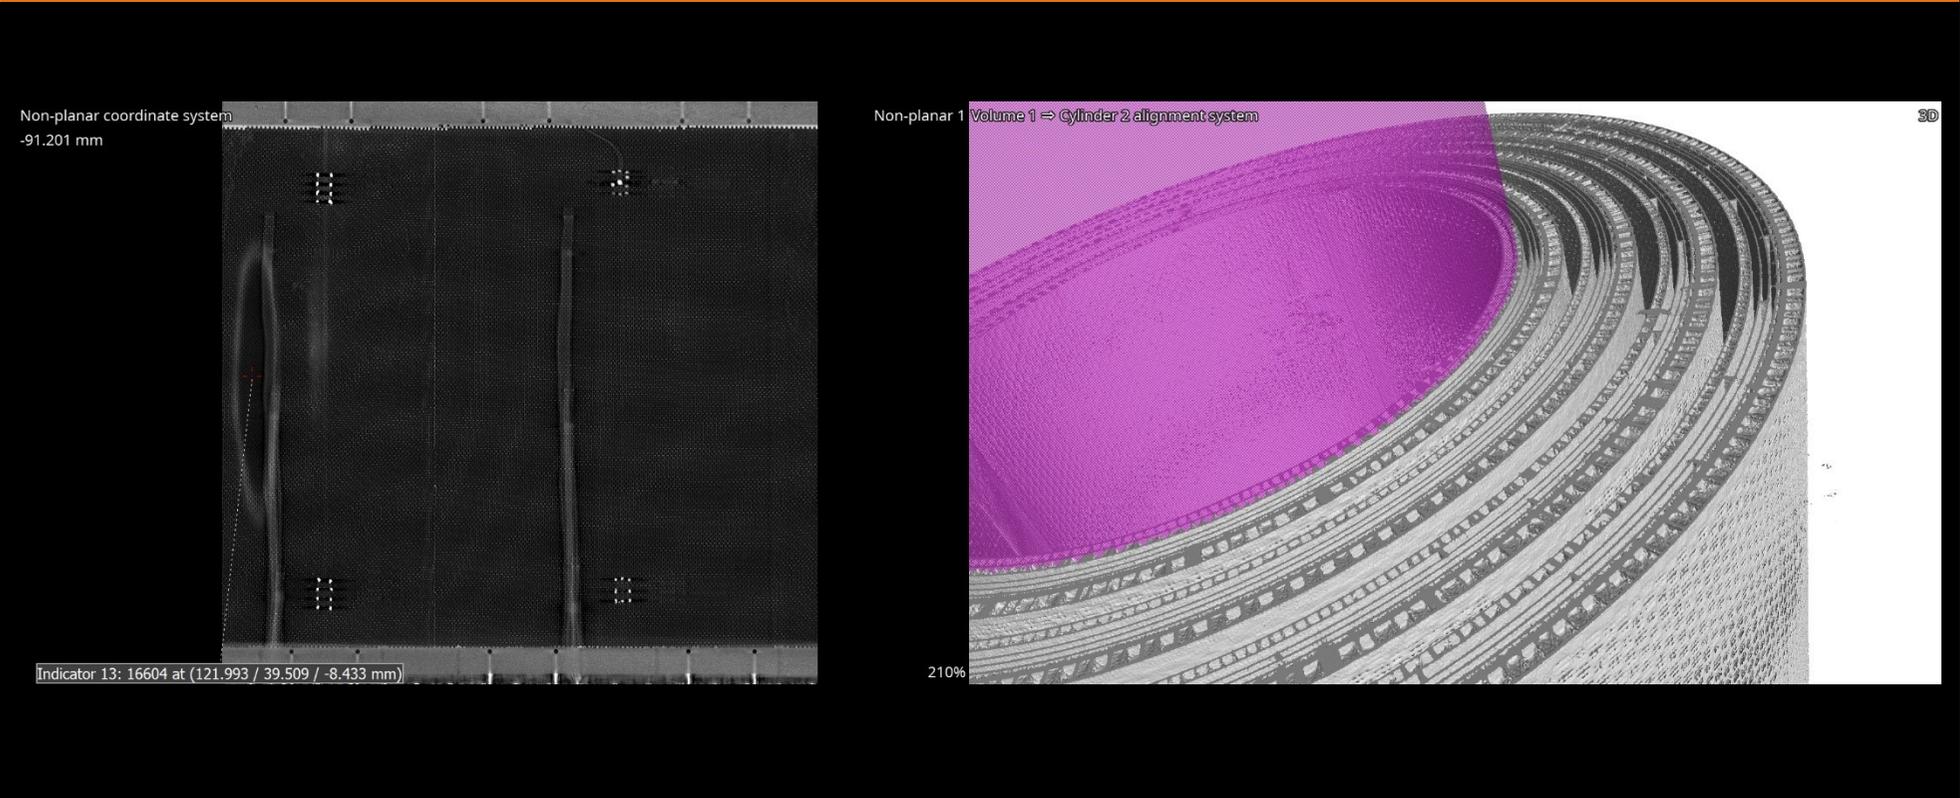


Firmato digitalmente da: BENUZZI STEFANO - Responsabile di Commessa

(1) Dati forniti dal cliente
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

Rapporto di Prova Test Report	21-05025-01 Pag. 24 di 24	Data Date	06/07/2021	Committente Customer	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA Via P. Giuria 1 10125 TORINO - TO
---	-------------------------------------	---------------------	------------	--------------------------------	---

RIVELATORE DI PARTICELLE

HONEYCOMB 4-2 – VISTA NON PLANARE

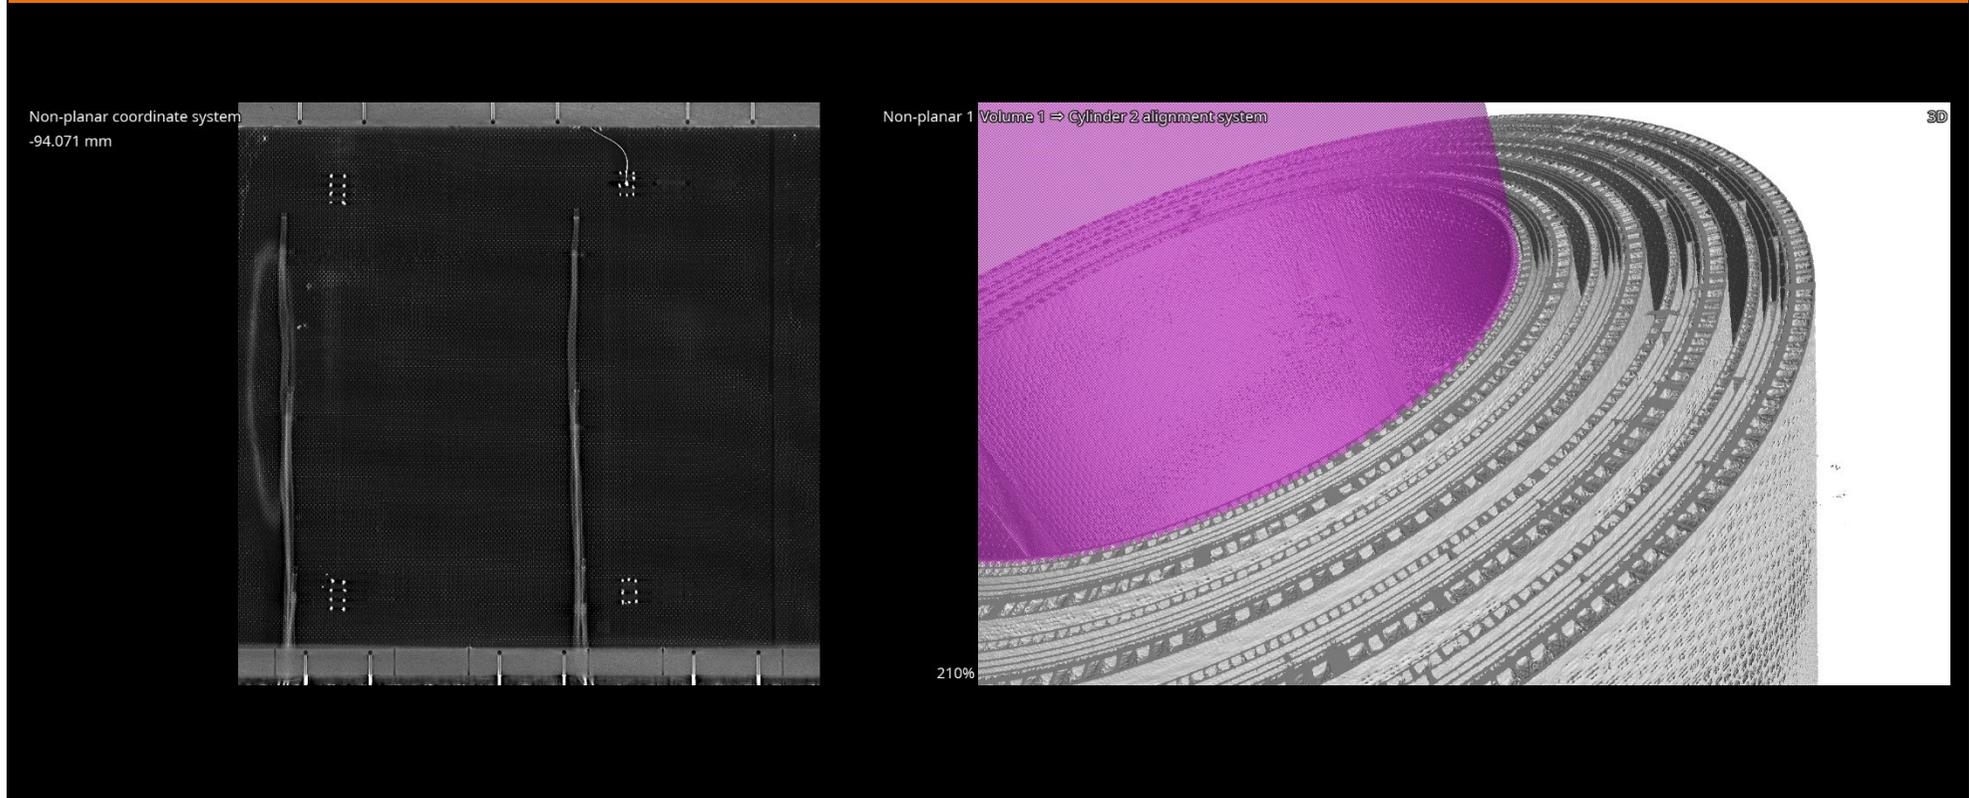

(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.